

Znak sprawy 6/2015

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.02.2015 r pod numerem 2015/S 032-053679 na dostawę odzieży medycznej jednorazowego i wielorazowego użytku, obłożenia pola operacyjnego, serwet, osłon urządzeń medycznych, masek, czepków, obuwia operacyjnego, zestawów do szycia w 36 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 20.02.2015 - 02.03.2015 od wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. pakietu Nr 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładów higienicznych o chłonności 1230 ml oraz wymiarze 60x60 cm.

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. dot. pakietu Nr 24

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga higieniczne podkłady ochronne wykonane z bibuły celulozowej pokrytej folią polietylenową 50x 80cm (brak wymaganej długości rolki).

Prosimy o podanie długości rolki

Czy należy zaoferować 200 szt. rolek, czy 200 szt. podkładów o wymiarach 50 x80cm.

Ad. 2. Należy zaoferować 200 rolek. Każda rolka o dł. min. 50 mb

3. dot. pakietu Nr 28 poz. 7

Prosimy o określenie gramatury włókniny z jakiej ma być wykonany fartuch. Ma to wpływ na jakość wyrobu (gramatura min. 25g/m² - 30g/m²) oraz przede wszystkim na cenę.

Ad. 3. Zamawiający wymaga gramatury min. 25 g/m²

4. dot. pakietu Nr 19 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na przewody o wymiarach 15 x 260cm?

Ad. 4. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

5. dot. pakietu Nr 19 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na mikroskop o wymiarach 117 x 203cm z soczewką wypukłą nie dającą odbić pryzmatycznych światła ?. Pokrowiec spełniający pozostałe wymagania SIWZ

Ad. 5. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wymiar 115x200 określił jako wymiar minimalny.

6. dot. pakietu Nr 19 poz. 4

Zwracamy, się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na przewody o wymiarach 15 x 260cm?. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy, się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 4 do oddzielnego pakietu co umożliwi znacznie szerszej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Ad. 6. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

7. dot. pakietu Nr 34 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) O gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przesyć) - nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianość co najmniej 4l.

Ad. 7. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

8. dot. pakietu Nr 34 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga aby zaproponowane podkłady posiadały rdzeń chłonny na całej długości co maksymalnie zwiększy jego chłonność.

Ad. 8. Zamawiający wymaga podkładów zgodnych z treścią SIWZ (załącznik Nr 34)

9. dot. pakietu Nr 34 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga aby zaproponowane podkłady posiadały chłonność min. 4L.

Ad. 9. Zamawiający wymaga podkładów zgodnych z treścią SIWZ (załącznik Nr 34)

10. dot. pakietu Nr 34 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga, aby zaproponowane podkłady posiadały rdzeń chłonny całkowicie gładki co minimalizuje ryzyko uszkodzeń skóry pacjenta?

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

11. dot. pakietu Nr 34

W przypadku przeliczenia ilości opakowań i uzyskania ułamkowej liczby prosimy o potwierdzenie czy należy wyliczyć ilość opakowań zaokrąglając ilości zgodnie z zasadami matematyki, zaokrąglić w górę czy wycenić ilość ułamkową?

Ad. 11. Jednostką miary w pakiecie Nr 34 są sztuki. Należy wycenić dokładną wymaganą przez Zamawiającego ilość sztuk bez ułamków.

12. Pytanie ogólne

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Ad. 12. Zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 wzoru umowy towar ma być dostarczony w konkretne miejsce siedziby Zamawiającego tj. magazyn medyczny / apteka szpitalna. Za dostarczenie towaru w konkretne miejsce całościowo odpowiada Wykonawca a nie magazynierzy Zamawiającego. Obecność pracownika Wykonawcy/ zleconego dostawcy towaru przy sprawdzeniu jest zależna od sytuacji (ilości i różnorodności towaru) i zależy od decyzji magazyniera Zamawiającego, który kwituje odbiór towaru.

13. Pytanie ogólne

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytego wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Ad. 13. Nie. Towar nie musi być dostarczany własnymi środkami transportu Wykonawców.

14. Pytanie ogólne

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej)

Ad. 14. Zamawiający nie wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi, aczkolwiek za jakość dostarczonego towaru, który musi być zgodny z umową oraz ewentualne jego uszkodzenie w trakcie transportu odpowiada Wykonawca.

15. Pytanie ogólne

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach ?

Ad. 15. Za dostarczenie towaru zgodnie z postanowieniami umowy odpowiada Wykonawca a nie Zamawiający. Tym samym o odpowiednim środku transportu dla przewożonego towaru decyduje Wykonawca.

16. dot. Pakietu nr 1

Zamawiający w Pakiecie nr 1 złożył zamówienie na serwety z tkaniny elanobawełnianej o różnej konstrukcji i wymiarze, wykonane z tkaniny o zawartości bawełny co najmniej 65%, o masie powierzchniowej 150 g/m², z przędzy bawełniano - poliestrowej 20 tex, gęstość po osnowie min 420 nitek na dm, po wątku min. 280 nitek na dm. W ofercie posiadamy nieprzemakalne serwety wykonane z niepylającej tkaniny bawełniano – poliestrowej o nieco większej niż wymagana w SIWZ gramaturze. Serwety posiadają nitkę węglową, która odprowadza ładunki elektryczne, co również jest nie bez znaczenia przy zabiegach chirurgicznych. Serwety zgodne z normą PN-EN 13795, posiadają deklarację CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. Kurczliwość do 5%.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 serwety wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej z dodatkiem nitki węglowej o gramaturze 160 g/m2 oraz kurczliwości do 5%? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

Ad. 16. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

17. dot. Pakietu nr 2

Zamawiający w Pakiecie nr 2 złożył zamówienie na odzież operacyjną wykonaną z tkaniny poliestrowej o gramaturze 155 —165 g/m2.

W ofercie posiadamy bardzo komfortowe ubrania bawełniano - poliestrowe 60% bawełna, 40% poliestr o gramaturze 125 g/m2. Ubrania posiadają bardzo duże właściwości „oddychania”, co jest spowodowane dużą zawartością bawełny. Włókna poliestrowe z kolei powodują, że są one bardzo wytrzymałe. Dzięki niższej gramaturze niż wymagana w SIWZ, oferowane przez nas ubrania są o około 25% tańsze w praniu, a także zapewniają większą przepuszczalność powietrza. **Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort użytkowania oraz ekonomikę prania, dopuści w Pakiecie nr 2 odzież operacyjną wykonaną z tkaniny bawełniano - poliestrowej 60% bawełna, 40% poliestr o gramaturze 125 g/m2? Proponowana przez nas odzież jest zdecydowanie bardziej komfortowa od opisanej w SIWZ.**

Ad. 17. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania koloru określonego w SIWZ.

18. dot. Pakietu nr 2

Zamawiający w Pakiecie nr 2 złożył zamówienie na odzież operacyjną m. in. w kolorze pomarańczowym. **Czy Zamawiający dopuści odzież w kolorze czerwonym, zamiast pomarańczowym?**

Ad. 18. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie odzieży w postaci nadruku w kolorze białym lub czarnym, gdzie wielkość liter wynosi 1 cm? Proponowany sposób oznakowania jest bardzo trwały i estetyczny.

Ad. 19. Zamawiający nie wyraża zgody.

20. dot. Pakietu Nr 3

Zamawiający w Pakiecie nr 3 złożył zamówienie na fartuchy operacyjne standardowego i wysokiego ryzyka. W ofercie posiadamy fartuchy, które w polu niekrytycznym wykonane są z tkaniny bawełniano - poliestrowej o składzie 60% bawełna, 40% poliestr o gramaturze 125 g/m2. Fartuchy są komfortowe oraz bezpieczne dla Użytkowników, ponieważ w polu krytycznym wykonane są z wysokobarierowych tkanin zapewniających maksimum bezpieczeństwa, natomiast w polu niekrytycznym z oddychających tkanin bawełniano - poliestrowych.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 fartuchy operacyjne standardowego i wysokiego ryzyka wykonane w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano - poliestrowej o składzie 60% bawełna, 40% poliestr o gramaturze 125 g/m2? Proponowane fartuchy są zgodne z normą PN-EN 13795.

Ad. 20. Zamawiający nie wyraża zgody.

21. dot. Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 fartuchy operacyjne wysokiego ryzyka wykonane w polu krytycznym z trójwarstwowego laminatu z membraną poliuretanową, w których elementy tkaninowe są szyte szwem krytym zawijanym dwuigłowym stębnowanym, dzięki czemu nie ma potrzeby uszczelniania ich taśmą poliuretanową?

Ad. 21. Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 2 przy zachowaniu pozostałych wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

22. dot. Pakietu Nr 32

Zamawiający w Pakiecie Nr 32 złożył zamówienie na buty operacyjne podlegające sterylizacji, z wyjmowaną wkładką silikonową. W ofercie posiadamy buty operacyjne nie podlegające sterylizacji oraz bez wkładki. Oferowane przez nas buty operacyjne są najwyższej jakości.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 32 buty operacyjne nie podlegające sterylizacji, bez wyjmowanej wkładki silikonowej, z anatomicznie wyprofilowaną powierzchnią styku ze stopą w części palców i śródstopia? Oferowane obuwie jest najwyższej jakości, co sprawia, że może być długo użytkowane oraz zapewnia maksymalny komfort pracy. Oferowane buty podlegają myciu i dezynfekcji z temperaturze 85°C. Dostępne w rozmiarach od 35 do 47.

Ad. 22. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

23. dot. Pakietu Nr 30

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 złożył zamówienie na buty operacyjne. Zamawiający wymaga, aby obuwie operacyjne posiadało oznakowanie zgodności CE. W ofercie posiadamy buty będące wyrobem ochronnym z podstawową stawką VAT, tj. 23%.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 32 obuwie operacyjne będące wyrobem ochronnym, opodatkowane stawką VAT 23% oraz złożenie oświadczenia, że oferowane buty są wyrobem ochronnym, w związku z czym odstąpi od wymogu załączenia deklaracji zgodności z Dyrektywą Medyczną 93/42?

Ad. 23. Zamawiający nie wyraża zgody

24. dot. Pakietu Nr 34, pozycja Nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego na stół operacyjny o chłonności 3,5L. Podkład nie posiadający rdzenia chłonnego na całej długości. Spełniający pozostałe wymagania SIWZ?.

Ad. 24. Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca nie określił wielkości rdzenia chłonnego dlatego Zamawiający nie dopuszcza.

25. dot. Pakietu Nr 34, pozycja Nr 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu nie posiadającego powierzchni chłonnej całkowicie gładkiej?.

Ad. 25. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

26. dot. Pakietu Nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny barierowy, wielokrotnego użytku, standardowego ryzyka wykonany z gęstej poliestrowej tkaniny zapewniającej barierowość. Tkanina nie powoduje uczuleń i podrażnień. Wykonany w całości z włókniny o gr. 84 g/m2, przenikanie cieczy na poziomie 54 H2O. Rękawy wykończone długim poliestrowym mankietem z wszytą tasiemką do założenia na palec, kolor

niebieski lub zielony. Fartuch zachowuje właściwości barierowe przez min. 100 cykli prania i sterylizacji.

Ad. 26. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

27. dot. Pakietu Nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny barierowy, wielokrotnego użytku, wysokiego ryzyka zapewniający swobodę ruchów. Fartuch wykonany jest z dwóch rodzajów tkanin. Przednia część fartucha oraz przedramiona, które narażone są na bezpośredni kontakt z polem operacyjnym wykonane są z trójwarstwowego laminatu dzianiny poliestrowej z poliuretanową membraną, która gwarantuje wysoką barierowość i chłonność. Ramiona oraz tylna część fartucha wykonana jest z gęstej poliestrowej tkaniny zapewniającej barierowość i dobrą przepuszczalność powietrza. Fartuch wykonany z tkaniny o gramaturze w strefie mniej krytycznej min. 80 g/m² i gramaturze laminatu w strefie krytycznej min. 150 g/m². Zawartość nitki węglowej wszytej na całej powierzchni fartucha daje równomierne odprowadzenie ładunków elektrycznych. Rękawy wykonane z długim poliestrowym mankietem z wszytą tasiemką do założenia na palec. Dodatkowo rękawy uszczelnione są od wewnętrznej strony specjalną taśmą wzmacniającą, dzięki czemu szwy nie przepuszczają płynów. Fartuch kolor niebieski lub zielony. Fartuch zachowuje właściwości barierowe przez min. 100 cykli prania i sterylizacji.

Ad. 27. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

28. dot. Pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	L2	260x240	WYCIEC. U	100x20
serweta z przylepcem	1	L2	240x150		
pokrowiec na nogę	1	L2	120x37		
kieszka na płyny z kształtką	1	PE - 1K	40x30		
taśma medyczna	6	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stół Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Ad. 28. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

29. dot. Pakietu Nr 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestetycznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1	L3	260x240
serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
kieszka na płyny	1	PE - 2K	42x35
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stół Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Ad. 29. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

30. dot. Pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	TF	200x180
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	TF	90x75
serweta z przylepcem	1	TF	180x180
serweta na stół Mayo	1		145x80
serweta na stół instrum.	1		190x150

Ad. 30. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

31. dot. Pakietu Nr 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z workiem na płyny i folią chir.	1	L3	240x200	PROST.	25x20
serweta z przylepcem	2	L3	60x50		
serweta	2	L3	90x75		
kieszonka dwukomorowa z kształtką	2	PE - 2K	42x35		
kieszonka na płyny z kształtką	2	PE - 1K	40x30		
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20		

Ad. 31. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

32. dot. Pakietu Nr 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie

serweta z wycięciem i przylepcem	1	L2	240x150	WYCIĘC. U	63x7
serweta z przylepcem	1	L2	240x180		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9		

Ad. 32. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

33. dot. Pakietu Nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x80cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 33. Zamawiający nie wyraża zgody

34. dot. Pakietu Nr 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 34. Zamawiający nie wyraża zgody

35. dot. Pakietu Nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach 67x90cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 35. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

36. dot. Pakietu Nr 24 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny na rolce w rozm. 51x80cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 36. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, przy czym min. dł. rolki to 50mb

37. dot. Pakietu Nr 26

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie?

serweta z elementem elastycznym i otworem	1	L3	300x240	OKRĄG	4
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20		

Laminat serwety głównej dwuwarstwowy o gramaturze 73 g/m² z elastycznym otworem o średnicy 4cm.

Ad. 37. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

38. dot. wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 38. Tak

39. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „24 miesiące” zostało zastąpione wyrażeniem „12 miesięcy”?

Spełnienie wymogu 24-miesięcznego terminu ważności jest możliwe, ale wymagałoby zorganizowania specjalnej obsługi dostaw specjalnie dla Zamawiającego, co zwiększałoby koszty logistyczne związane z obsługą dostaw i miałoby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na wysokość oferowanej ceny. Nasuwa się wątpliwość czy wymaganie tak długiego terminu ważności jest rzeczywiście uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Czy Zamawiający zamierza przechowywać zakupiony towar przez 2 lata?

Ad. 39. Zamawiający nie wyraża zgody

40. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 5 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godzin” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótki, liczony w godzinach termin załatwiania reklamacji miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na wysokość oferowanej ceny.

Ad. 40. Tak, przy czym jeśli upływ terminu przypada na dni sobota, niedziela lub święto wówczas upływ terminu mija do godz. 15 pierwszego dnia roboczego.

41. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „serię oraz datę ważności dla poszczególnych pozycji”?

Seria i data ważności nie podlegają obowiązkowemu zamieszczeniu na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego zamieszczanie tych informacji bezpośrednio na fakturze nie jest praktykowane. Wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich danych na fakturze. W tej sytuacji, spełnienie wymogu zamieszczenia serii i daty ważności bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynąć na wysokość oferowanej ceny.

Ad. 41. Wzór umowy nie ma ust. 3 w paragrafie 3, więc Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi.

42. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.”? Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Ad. 42. Zamawiający nie wyraża zgody

43. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto danego zamówienia” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby zwłoka w dostawie dotyczyła tylko części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Ad. 43. Zamawiający nie wyraża zgody

44. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338114; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 4831 nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Ad. 44. Zamawiający nie wyraża zgody

45. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy słowo „musi” zostało zastąpione słowem „może”?

Informacja o zakazie cesji wierzytelności nie musi być zamieszczana na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie powyższych informacji bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynąć na wysokość oferowanej ceny. Jednocześnie, zamieszczanie powyższych informacji na fakturze nie jest konieczne do ochrony interesów Zamawiającego, a w szczególności nie zmienia sytuacji prawnej Zamawiającego. Bezskuteczność czynności prawnej powodującej zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a dokonanej bez zgody podmiotu tworzącego, wynika wyraźnie z mocy art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej; jest zatem zupełnie niezależna od ewentualnej wzmianki na fakturze.

Ad. 45. Zamawiający nie wyraża zgody

46. dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu posiadania numeru umowy na fakturze, zamiast tego zgodzi się, aby ten numer znajdował się na dokumencie WZ?

Ad. 46. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

47. dot. Pakietu Nr 24 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 24 poz. 1 i 2 serwety z włókniny trójwarstwowej SMS?

Ad. 47. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów wyrobu.

48. dot. Pakietu Nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 24 poz. 2 serwety o wymiarowaniu 80x75 cm?

Ad. 48. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

49. dot. Pakietu Nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 24 poz. 3 kompletu

pościeli z poszewką o wymiarowaniu 70x80cm?

Ad. 49. Zamawiający nie wyraża zgody.

50. dot. Pakietu Nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 24 poz. 5 fartucha przedniego foliowego o wymiarowaniu 69x122cm?

Ad. 50. Zamawiający nie wyraża zgody.

51. dot. Pakietu Nr 24 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 24 poz. 6 podkładów w rolce o szerokości 50cm, długości 50 m, z perforacją co 37 cm?

Ad. 51. Zamawiający nie wyraża zgody.

52. dot. Pakietu Nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu Nr 28 poz. 3 czepka w części bocznej wykonanego z podwójnej warstwy chłonnej wiskozowej bez wydłużenia z możliwością wywinięcia?

Ad. 52. Zamawiający nie wyraża zgody.

53. dot. Pakietu Nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu Nr 30 poz. 1 koszuli z wycięciem w serek pod szyją?

Ad. 53. Zamawiający nie wyraża zgody.

54. dot. Pakietu Nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu Nr 30 poz.1 koszuli wiązanej w pasie, a u góry zapinanej na rzep?

Ad. 54. Tak, Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów.

55. dot. Pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku o następujących wymiarach:

1. serweta chirurgiczna górna o wymiarach 200x150 cm, z wycięciem U o wymiarach 50x10 cm z taśmą samoprzylepną	200x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną	220x180	1
3. osłona na kończynę	37x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Ad. 55. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

56. dot. Pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści aby taśmy lepne w zestawie do zabiegów artroskopii kolana posiadały wymiar min. 9 x 49 cm oraz zawierały dodatkowo w składzie ręczniki chłonne przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 56. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

57. dot. Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści aby taśmy lepne w zestawie do zabiegów na stawie kolanowym posiadały wymiar min. 9 x 49 cm oraz zawierały dodatkowo w składzie ręczniki chłonne, przewód drenażowy oraz osłonę na przewody przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 57. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

58. dot. Pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego o następującym składzie i wymiarach:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150x240 cm	150x240	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x290 cm z wycięciem U o wymiarach 9x100 cm z taśmą samoprzylepną	200x290	1
3. osłona na kończynę	37x105	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	3
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
7. osłona na stół MAYO	79x145	1
8. osłona na stół - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Ad. 58. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

59. dot. Pakietu Nr 9

Czy Zamawiający dopuści aby warstwa chłonna w zestawie do zabiegów urologicznych posiadała wymiar min. 40 x 35 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 59. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

60. dot. Pakietu Nr 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych TUR o następujących wymiarach:

1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 150x240 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na pręcie o wymiarach 5x7 cm i bezłateksową osłonę na palec do badania per rectum, otwory otacza warstwa chłonna o wymiarach 40x35 cm, serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu	150x240	1
2. przewód drenażowy	0,8x140	1
3. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Ad. 60. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

61. dot. Pakietu Nr 11

Czy Zamawiający dopuści, aby w zestawie do zabiegów ginekologicznych dolnych serweta główna posiadała otwór o wymiarze min. 10 x 15 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 61. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

62. dot. Pakietu Nr 12

Czy Zamawiający dopuści, aby zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych nie posiadał w swoim składzie serwety pod pośladki o wymiarach 75 x 90 cm przy zachowaniu pozostałego składu i parametrów lub też ta serweta była pakowana osobno?

Ad. 62. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zestaw bez wymienionej serwety.

63. dot. Pakietu Nr 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu angiografii udowej o następującym składzie i wymiarach:

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 220x300 cm z przezroczystą foliową wstawką o wymiarach 70x300 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa zasłepione otwory w okolicach tt. udowych (Ø 8,5 cm) otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100x75 cm | 220x300 | 1 |
| 2. ręczniki chłonne | 30x40 | 4 |
| 3. osłona na głowicę RTG | Ø 50 | 1 |
| 4. osłona na ekran radiologiczny | Ø 80 | 1 |
| 5. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |

Ad. 63. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

64. dot. Pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści, aby taśmy lepne w zestawie serwet uniwersalnych posiadały wymiar min. 9 x 49 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 64. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

65. dot. Pakietu Nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 sterylne pokrowiec o wymiarach 17 x 200 cm wykonany z folii PE lub w przypadku negatywnej odpowiedzi o wyłączenie tej pozycji z pakietu oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie?

Ad. 65. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowany pokrowiec.

66. dot. Pakietu Nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie sterylnej fartucha chirurgicznego-do procedur standardowych, wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; wyposażonego w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem o następujących parametrach: odporność materiału ze wzmocnieniem na przenikanie cieczy 149 cm H₂O, szwów rękawów 138 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 149/125 kPa, Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, min. 2 celulozowe ręczniki, zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe?

Ad. 66. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

67. dot. Pakietu Nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie sterylnej fartucha chirurgicznego-do procedur standardowych, wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o

gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem o następujących parametrach: odporność materiału na przenikanie cieczy 61cm H₂O, odporność na rozierwanie na sucho/mokro 149/125 kPa, opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, min. 2 celulozowe ręczniki, zgodny z normą PN EN 13795-wymagania standardowe?

Ad. 67. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

68. dot. Pakietu Nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano serwetę z otworem 7cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 68. Zamawiający nie wyraża zgody.

69. dot. Pakietu Nr 22 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3 zaoferowano serwetę z otworem 7 cm lub 9x12cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 69. Zamawiający nie wyraża zgody.

70. dot. Pakietu Nr 22 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 7 zaoferowano osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x145cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Ad. 70. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

71. dot. Pakietu Nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano serwety o wymiarach 80 x 100 cm?

Ad. 71. Zamawiający nie wyraża zgody.

72. dot. Pakietu Nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3 zaoferowano zestaw pościelowy w składzie: poszewka 80x90cm, poszew 140x210cm i prześcieradło 130x210cm?

Ad. 72. Zamawiający nie wyraża zgody.

73. dot. Pakietu Nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 5 zaoferowano fartuch przedni o wymiarach: 08x1,3m?

Ad. 73. Zamawiający nie wyraża zgody.

74. dot. Pakietu Nr 24 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 6 zaoferowano podkład w rolce o rozmiarze pojedynczego odcinka 50x50cm (szerokość rolki 50cm, perforacja co 50cm i długość rolki 50mb)? Jednocześnie prosimy o informację czy wymagana ilość 200 szt. dotyczy pojedynczych odcinków czy ilości rolek.

Ad. 74. Zamawiający nie dopuszcza wymiaru pojedynczego odcinka 50x50cm.
Jednocześnie informuje, że wymaga ilość dotyczy rolek - min. dł. rolki to 50mb.

75. dot. Pakietu Nr 26

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy o następującym składzie i wymiarach:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
3. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)	150x190	1

lub:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. serweta na stół	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)	150x190	1

Ad. 75. Zamawiający dopuszcza pierwszy z w/w.

76. dot. Pakietu Nr 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o następującym składzie i wymiarach:

1. serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120x120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 80x50 cm. Serweta wyposażona w worek z siem do przechwytywania płynów o wymiarach 86x56 cm, z możliwością podłączenia drenu	120x120	1
2. serweta - owinięcie noworodka	80x90	1
3. ręczniki chłonne	30x40	2
4. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Ad. 76. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

77. dot. Pakietu Nr 30

Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną zapinaną na górze na rzep oraz związaną w pasie na troki przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 77. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

78. dot. Pakietu Nr 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia o następującym składzie i wymiarach:

1. serweta na stół instrumentariuszki 150x 190cm, owinięcie zestawu -1 szt
2. serweta chirurgiczna o wymiarach 75 x 75 cm, wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze max 57,5 g/m² - 2 szt
3. serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 180 cm, wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze max 57,5 g/m² —2 szt
4. tuffer z gazy z nitką RTG —4 szt

5. miska niebieska, 250 ml —2 szt
6. ręcznik 30 cm x 40 cm —2 szt
7. kompres gazowy z nitką RTG, 12-warstwowy, 10x10cm —5 szt
8. strzykawka 20 ml dwuczęściowa - 1 szt
9. skalpel nr 11-1 szt
10. igła 0,80x60 mm-2 szt
11. skalpel nr 10-2 szt
12. kleszczyki do materiałów opatrunkowych - 1 szt

Wszystkie składowe (1-3) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Składowe od (4 -12) w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi

Zestaw wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 1-3, z nią zgodne.

Ad. 78. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

79. dot. Pakietu Nr 17

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 3 tygodni od daty podpisania umowy?

Ad. 79. Zamawiający nie wyraża zgody

80. dot. Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę okulistyczną wykonaną w całości w włókniny typu SMS o gramaturze 51 g/m², bez warstwy chłonnej spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 80. Zamawiający nie wyraża zgody.

81. dot. Pakietu Nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody wykonany z foli polietylenowej o gramaturze 50g/m²?

Ad. 81. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

82. dot. Pakietu Nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści-sterylny pokrowiec na ramię C 3-częściowy:
Część górna 100x160cm gramatura 65g/m², część dolna 80x150cm oraz 2x taśma przylepna 3x100cm?

Ad. 82. Zamawiający nie wyraża zgody.

83. dot. Pakietu Nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m² + wzmocnienie 28g/m² z rękawem standardowym (nie typu reglan), spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 83. Zamawiający nie wyraża zgody.

84. dot. Pakietu Nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m² z rękawem standardowym (nie typu reglan), spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 84. Zamawiający nie wyraża zgody.

85. dot. Pakietu Nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm lub o średnicy 7cm?

Ad. 85. Zamawiający nie wyraża zgody.

86. dot. Pakietu Nr 22 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm lub o średnicy 7cm?

Ad. 86. Zamawiający nie wyraża zgody.

87. dot. Pakietu Nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

Ad. 87. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

88. dot. Pakietu Nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm lub o średnicy 7cm, spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 88. Zamawiający nie wyraża zgody.

89. dot. Pakietu Nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednokomorową torbę na płyny foliową, przezroczystą z przylepcem, ze sztywnikiem z filtrem i końcówką do podłączenia ssaka w rozmiarze 50x80cm?

Ad. 89. Zamawiający nie wyraża zgody.

90. dot. Pakietu Nr 23 poz. 4

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję i utworzy z niej osobny pakiet?

Ad. 90. Zamawiający nie wyraża zgody.

91. dot. Pakietu Nr 23 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylą w rozmiarze 150x210cm spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 91. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

92. dot. Pakietu Nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli : powłoka 160x210cm, powłóczka 70x80cm, Prześcieradło 150x210cm, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 92. Zamawiający nie wyraża zgody.

93. dot. Pakietu Nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116cm?

Ad. 93. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

94. dot. Pakietu Nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej 30g/m² podfoliowany w rozmiarze L?

Ad. 94. Zamawiający wymaga fartucha zgodnego z wymogiem SIWZ (załącznik 24 poz. 5)

95. dot. Pakietu Nr 24 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje podkładu w rozmiarze 50cmx80cm?

Ad. 95. Zamawiający wymaga podkładów zgodnych z wymogiem SIWZ (załącznik 24 poz. 6)

96. dot. Pakietu Nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę spełniającą normy typu I?

Ad. 96. Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że wymaga min. typu II lub IIR

97. dot. Pakietu Nr 28 poz. 2

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję i utworzy z niej osobny pakiet?

Ad. 97. Zamawiający nie wyraża zgody

98. dot. Pakietu Nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści następujący czepek?

- Czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej
- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia
- Doskonała oddychalność
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



Ad. 98. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

99. dot. Pakietu Nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 99. Zamawiający nie wyraża zgody

100. dot. Pakietu Nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek cały perforowany spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 100. Zamawiający nie wyraża zgody

101. dot. Pakietu Nr 28 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek cały perforowany spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Ad. 101. Zamawiający nie wyraża zgody

102. dot. Pakietu Nr 28 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem z gumką?

Ad. 102. Zamawiający nie wyraża zgody

103. dot. Pakietu Nr 30

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

Ad. 103. Zamawiający nie wyraża zgody

104. dot. Pakietu Nr 4

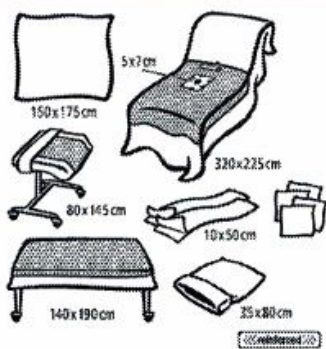
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii barku o następującym składzie:

Zestaw do artroskopii stawu barkowego I wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy	140 x 190
wzmocniona	
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (10 x 60 cm)	260 x 200
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240
1 osłona na kończynę	25 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Ad. 104. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

105. dot. Pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów na stawie kolanowym o następującym składzie:

		Zestaw do zabiegów na kończynie I wzmocniony Skład zestawu: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 1 osłona na kończynę 35 x 80 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 4 ręczniki celulozowe 30 x 33
---	--	--

Ad. 105. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

106. dot. Pakietu Nr 6

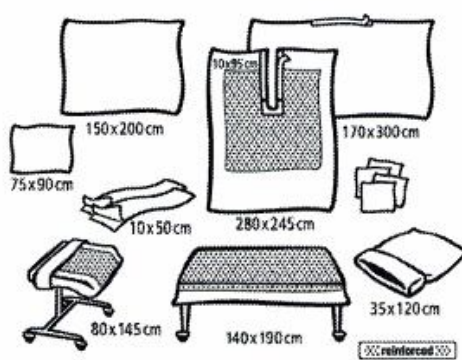
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów artroskopii kolana o następującym składzie?

- 1 serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta do artroskopii 245 x 320 cm z otworem z neoprenu 5 x 7 cm oraz workiem przechwytyjącym płyny
- 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

Ad. 106. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

107. dot. Pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

		Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra II wzmocniony Skład zestawu: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (10 x 95 cm) 245 x 280 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 1 osłona na kończynę 35 x 120 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 4 ręczniki celulozowe 30 x 33
---	--	---

Ad. 107. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

108. dot. Pakietu Nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów PCN L wykonanego z paraprzepuszczalnego i nieprzemakalnego, 2 warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa)? Pozostałe parametry serwet bez zmian

Ad. 108. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

109. dot. Pakietu Nr 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do przecewkowych zabiegów urologicznych TUR o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta Protect do zabiegów urologicznych TUR ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, z oknem nieprzylepnym 7x 10 cm, torbą do zbierania płynów 50 x 70 cm (z sitem i drenem i zaworem), osłoną na palec bezłateksową 200 x 185 cm

Ad. 109. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

110. dot. Pakietu Nr 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów ginekologicznych dolnych o następującym składzie:

- 1 x serweta 2-warstwowa z padem chłonnym 250x 290 cm, zintegrowana z nogawicami z otworem 9 x 12 cm w części kroczonej
- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 150 x 180 cm (opakowanie zestawu)

Ad. 110. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

111. dot. Pakietu Nr 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów brzuszno-kroczonego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którym serweta główna 2-warstwowa o wymiarach 250 x 300 cm z padem chłonnym, w części górnej ma otwór o wym. 26 x 30 cm wypełniony folią chirurgiczną, natomiast w części dolnej otwór 12 x 15 cm wraz z przysłaniającą klapą. Kieszeń 2-sekcyjna w oferowanym obłożeniu ma rozmiar 38 x 43 cm.

Ad. 111. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

112. dot. Pakietu Nr 14

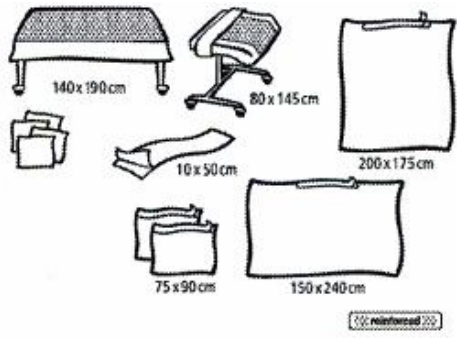
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów angiografii udowej, wykonanego z laminatu min. dwuwarstwowego o następującym składzie:

- 1 serweta angiograficzna z 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) w rozmiarze 210 x 300cm,
- z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe (ø9 cm)
- i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego (prawa strona pacjenta 60 x 300 cm)
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- 1 osłona na sprzęt medyczny okrągła 50 x 100 cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard rozmiar L
- 1 fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard rozmiar XL

Ad. 112. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

113. dot. Pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

		Zestaw uniwersalny II	
		Skład zestawu:	
		1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
		1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
		1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240
		1 samoprzylepna serweta operacyjna	200 x 175
		2 samoprzylepne serwetki operacyjne	75 x 90
		1 taśma samoprzylepna	10 x 50
		4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Ad. 113. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

114. dot. Pakietu Nr 16

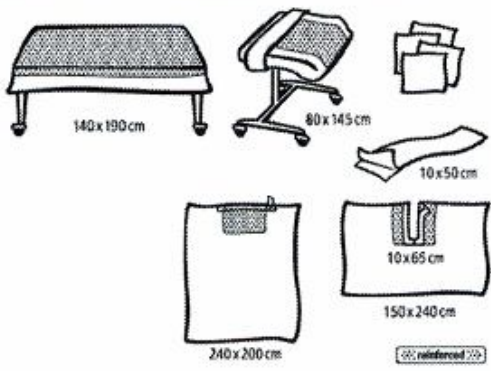
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2 - warstwowa 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta do zabiegów neurochirurgicznych 2-warstwowa z padem chłonnym o wym. 245 x 320 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną 19 x 30 cm, serweta wyposażona w worek do zbiórki płynów
- 2 x serwetki samoprzylepne 2- warstwowe 45 x 75 cm
- 1 x serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 x kieszeń 1-sekcyjna 38 x 34 cm
- 1 x kieszeń 2-sekcyjna 38 x 43 cm
- 2 x ręcznik celulozowy
- 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

Ad. 114. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

115. dot. Pakietu Nr 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów laryngologicznych o następującym składzie:

		Uniwersalny zestaw z serwetą z wycięciem U i wzmocniony	
		Skład zestawu:	
		1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
		1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
		1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” (10 x 65 cm) z padem chłonnym	150 x 240
		1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	200 x 240
		1 taśma samoprzylepna	10 x 50
		4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Ad. 115. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

116. dot. Pakietu Nr 20 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMMS, z rękawami wszytymi prosto, zapewniającymi swobodę ruchów?

Ad. 116. Zamawiający nie wyraża zgody

117. dot. Pakietu Nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych o gramaturze 40g/m², materiał wzmocnień 38g/m²? Wzmocnienie od wewnętrznej strony fartucha sięga ok. 10-15cm przed dolną krawędzią fartucha.

Ad. 117. Zamawiający nie wyraża zgody

118. dot. Pakietu Nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 75 cm lub 75 x 75 cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian?

Ad. 118. Zamawiający nie wyraża zgody

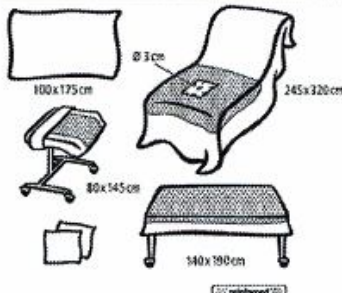
119. dot. Pakietu Nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni dwukomorowej w rozmiarze 43 x 38 cm wykonanej z mocnej półprzezroczystej „sztywnej folii, bez dodatkowego sztywnika?

Ad. 119. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

120. dot. Pakietu Nr 26

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy o następującym składzie:

		Zestaw do operacji dłoni/stopy I wzmocniony
		Skład zestawu:
1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona		140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona		80 x 145
1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm)		320 x 245
1 serweta nieprzylepna		100 x 175
2 ręczniki celulozowe		30 x 33

Serweta do operacji kończyny wykonana jest z laminatu o gramaturze 55g/m², wzmocnienie w części krytycznej 110 g/m². Serweta na stół Mayo ma wzmocnienie 60 x 85cm.

Ad. 120. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

121. dot. Pakietu Nr 28 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców na buty będących wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent zakwalifikował je jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym

Ad. 121. Zamawiający nie wyraża zgody

122. dot. Pakietu Nr 28 poz.7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego, posiadającego mankiety zakończone lekko uciskającą gumką?

Ad. 122. Zamawiający nie wyraża zgody

123. dot. Pakietu Nr 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

- 1 x serweta 2-warstwowa 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta 2-warstwowa pod pośladki 100 x 120 cm z dwoma workami
- 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
- 1 x serweta pod pośladki 2-warstwowa 100 x 120 cm

Ad. 123. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

124. dot. Pakietu Nr 30

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym

Ad. 124. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

125. dot. Pakietu Nr 31

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x kleszczyki plastikowe do dezynfekcji pola operacyjnego 24 cm
- 4 x tufier miękki z gazy z nitką Rtg 17N, (33 x 33cm)
- 2 x pojemnik plastikowy 250 ml
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 150 x 180 cm. Gramatura laminatu 55g/m²
- 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm. Gramatura laminatu 55g/m²
- 5 x kompres z gazy z nitką Rtg 10 x 10 cm, 17 n, 12w
- 1 x ostrze nr 10
- 1 x ostrze nr 11
- 1 x igła iniekcyjna
- 1 x strzykawka 20 ml typu Luer, 2-częściowa

Ad. 125. Zamawiający nie wyraża zgody

126. dot. projektu umowy, § 7 pkt. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kary umownej do wysokości 0,2% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Ad. 126. Zamawiający nie wyraża zgody

127. dot. SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści złożenie wykazu

dostaw, których przedmiotem są wyroby medyczne / jednorazowe wyroby medyczne.

Ad. 127. Zamawiający nie potwierdza. Proponowany w/w wykaz dostaw (wyroby medyczne / jednorazowe wyroby medyczne) jest przedstawiony bardzo ogólnie przedmiotowo i może w ogóle nie dotyczyć dostaw „tego samego rodzaju”. Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 5.1.2 SIWZ.

128. dot. pakietu Nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm, złożona teleskopowo, z taśmą mocującą
- 1 serweta pomocnicza 100 x 150 cm
- 1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym otworem, zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Ad. 128. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

129. dot. pakietu Nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90 cm
- 1 serweta 150 x 200 cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm
- 1 osłona na kończynę 35x120cm
- 2 OP Taśma 10x50cm

Ad. 129. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

130. dot. pakietu Nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 serweta główna 200 x 240 z otworem, zintegrowanymi osłonami na kończyny, zbiornikiem wyposażonym w sito oraz zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum
- 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Ad. 130. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

131. dot. pakietu Nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 szt. serweta 200x250cm ze zintegrowanymi nogawicami z samoprzylepnym otworem 8,5 x 15cm
- 1 szt. serwety na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm
- 1 szt. ręcznik 43x51cm

1 szt. serweta 102cm x 110cm

Ad. 131. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

132. dot. pakietu Nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;

1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm

4 ręczniki do rąk

1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Ad. 132. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

133. dot. pakietu Nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z włókniny 3 warstwowej typu SMS z polem wypełnionym folią chirurgiczną i dwiema zintegrowanymi kieszeniami.

Ad. 133. Zamawiający nie wyraża zgody

134. dot. pakietu Nr 24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 24 w celu zaoferowania prześcieradeł wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.

Ad. 134. Zamawiający nie wyraża zgody

135. dot. pakietu Nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny, 5 warstwową, powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z 2 scalonych powłok, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej w rozmiarze min. 100cm x 229cm +/- 5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 49 x 197 +1- 2 cm, warstwa spodnia pełno barierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej.

Ad. 135. Tak dopuści pod warunkiem spełnienia warunku chłonności określonej w pakiecie 34 poz. 1

136. dot. pakietu Nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny, 5 warstwową, powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z 2 scalonych powłok, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej w rozmiarze min. 100cm x 229cm +/- 5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 49 x 197 +/- 2cm, warstwa spodnia pełno barierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej, serweta do re pozycjonowania pacjenta w rozmiarze 165x85cm +/- 2cm

Ad. 136. Tak dopuści pod warunkiem spełnienia warunku chłonności określonej w pakiecie 34 poz. 2

137. dot. pakietu Nr 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 4, w pozycji nr 1 dopuści obłożenie do artroskopii barku wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny

polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przeniknięcie cieczy - min. 200 cm H₂O

Skład

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie „U” 7x60cm
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona (ekran anestetyczny) o wymiarach min. 150x240cm
- 1 serweta pod kończynę o min. wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Ad. 137. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

138. dot. pakietu Nr 5 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 5, w pozycji nr 1 dopuści sterylą serwetę przeznaczoną do zabiegów na stawie kolanowym wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przeniknięcie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x320cm z samouszczelniającym się owalnym otworem 5x7cm, z uchwytem („rzepem”) do mocowania kabli i drenów
- 1 serweta o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

Ad. 138. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

139. dot. pakietu Nr 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 6, w pozycji nr 1 dopuści zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego z kieszenią na narzędzia chirurgiczne oraz dren - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Skład

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne otwory w rozmiarach $\varnothing 7\text{cm}$, $\varnothing 5\text{cm}$, torba do zbiórki płynów z zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne
- 1 dren 150 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Ad. 139. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

140. dot. pakietu Nr 7 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 7, w pozycji nr 1 dopuści zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przeniknięcie cieczy - min. 200 cm H₂O.

Skład

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie „U”
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji

Ad. 140. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

141. dot. pakietu Nr 9 i 10

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie Nr 9 oraz w pakiecie Nr 10 w pozycji Nr 1 dopuści jałowy zestaw do zabiegów urologicznych – serwety niezawierające ceulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład:

- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm posiadająca: zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłonę na palec

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji

Ad. 141. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

142. dot. pakietu Nr 11 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie Nr 11 w pozycji Nr 1 dopuści jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych – serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przeniknięcie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145 cm
- 1 serweta główna wzmocniona o min. wym. 290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem
- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przezroczystego PE
- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90 cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji

Ad. 142. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

143. dot. pakietu Nr 12 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 12 w pozycji nr 1 dopuści jałowy zestaw brzuszno - kroczy - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm,
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane. nogawice, 2 okna: jama brzuszna - przylepne i okolice krocza – nieprzylepne okno oraz 3. uchwyty do mocowania kabli i drenów
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji

Ad. 143. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

144. dot. pakietu Nr 13 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 13 w pozycji nr 1 dopuści jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknięcie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem z folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spuniace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Ad. 144. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

145. dot. pakietu Nr 14 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 14 w pozycji nr 1 dopuści jałowy zestaw do angiografii udowej - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknięcie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład:

- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 210x270cm posiadająca 2 samoprzylepne otwory wypełnione folią chirurgiczną, boczna strefa do nakrycia aparatury z przezroczystej folii PE
- 1 uchwyt do mocowania drenów („rzep”)
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Ad. 145. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

146. dot. pakietu Nr 15 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 15 w pozycji nr 1 dopuści jałowy zestaw serwet uniwersalnych - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przeniknięcie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spuniace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Ad. 146. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

147. dot. pakietu Nr 18 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 18 w pozycji nr 1 dopuści jałowy zestaw laryngologiczny- serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O.

Skład

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna przylepna z wycięciem „U”- minimalne wymiary 125x150cm
- 1 serweta samoprzylepna 200x200cm
- 1 serweta samoprzylepna 75x75cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spuniace 9x50cm,
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Ad. 147. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

148. dot. pakietu Nr 20 poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 20 w pozycjach od nr 1 do nr 2 dopuści jałowy fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS?

Ad. 148. Zamawiający nie wyraża zgody

149. dot. pakietu Nr 22

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie Nr 22 w pozycji od nr 1 dopuści serwety jałowe z włókniny 180cm x 150cm?

Ad. 149. Zamawiający nie wyraża zgody

150. dot. pakietu Nr 26 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 26 w pozycji nr 1 dopuści jałowy zestaw do chirurgii dłoni/stopy - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²

wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy — min. 200 cm H₂O. Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy 220x320 cm z elastycznym otworem w

rozmiarze $\varnothing 3$ cm i zintegrowanym uchwytem na dreny
- 2 ręczniki 30x40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Ad. 150. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

151. dot. pakietu Nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 2 ręczniki 30 x 40cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm
- 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 x 50cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 24 x 80cm
- 1 serweta do artroskopii stawu barkowego, 225 x 380cm z elastycznym otworem w kształcie gruszki, 11,5 x 12,5cm ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu, z 3 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

- 1 owinięcie zestawu 80 x 100 cm papier (do sterylizacji)
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm
- 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 serweta z wycięciem, dwuwarstwowa 225 x 260 cm z wycięciem 10 x 100 cm

Ad. 151. Tak, Zamawiający dopuszcza pierwszy z w/w.

152. dot. pakietu Nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 2 ręczniki 30 x 40cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm
- 1 serweta operacyjna, dwuwarstwowa 150 x 180cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55cm
- 1 foliowy pasek samoprzylepny 10 x 50cm
- 1 serweta na kończynę, dwuwarstwowa Plus, 225 x 320cm z elastycznym otworem 7cm oraz z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej 50x100cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Ad. 152. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

153. dot. pakietu Nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 2 ręczniki 30 x 40cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm
- 1 serweta operacyjna, dwuwarstwowa 150 x 180cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55cm
1 foliowa taśma samoprzylepna 10 x 50cm
1 serweta do artroskopii kolana, 225 x 320cm z elastycznym otworem, 6+ 7 ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu, z uchwytami do mocowania przewodów i drenów, z uchwytem typu rzep do mocowania przewodów?

Ad. 153. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

154. dot. pakietu Nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
4 ręczniki 30 x 40cm
1 serweta na stół Mayo Special (wzmocniona laminatem dwuwarstwowym, gramatura całości 156 g/m²) 80 x 145cm
1 taśma samoprzylepna 9 x 50cm
1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa 75 x 90cm
1 serweta operacyjna, dwuwarstwowa 150 x 180cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 110cm
2 foliowe taśmy samoprzylepne 10 x 50cm
1 serweta 225 x 280 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, z wycięciem „U” 10 x 100cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta anestetyczna ze wzmocnieniem w strefie krytycznej 225 x 270cm z wycięciem 45 x 65cm i osłoną podpórek kończyn górnych? Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Ad. 154. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

155. dot. pakietu Nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
2 ręczniki 30 x 40cm
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24 cm
1 serweta do procedur TUR II, 175/260 x 245cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z samoprzylepnym otworem w okolicy odbytu 7 x 10cm ze zintegrowanym sitkiem, z samoprzylepnym otworem nadłonowym o średnicy 8cm z bezłateksową osłoną na palec?

Ad. 155. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

156. dot. pakietu Nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
2 ręczniki 30 x 40cm
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24 cm
1 serweta do procedur TUR I, 225/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy odbytu 5cm, z otworem nadłonowym 8cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu, z bezłateksową osłoną na palec? Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.(na sali urologicznej)

Ad. 156. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

157. dot. pakietu Nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

2 ręczniki 30 x 40cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 50cm

1 serweta pod pacjenta, dwuwarstwowa 75 x 120cm

1 serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych 175/260 x 210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z samoprzylepnym otworem w okolicy odbytu 10 x 15cm?

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię

Ad. 157. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

158. dot. pakietu Nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

4 ręczniki 30 x 40cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm

1 serweta pod pacjenta 75 x 120cm

1 serweta Rectum II, 260 x 310cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z samoprzylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 35 x 37cm otoczonym folią chirurgiczną- rozmiar okna 28 x 32cm, z otworem w okolicy odbytu 10 x 15cm wraz z przysłaniającą go kłapką z możliwością przylepienia jej, z 2 dwukomorowymi zintegrowanymi kieszeniami na narzędzia 38 x 40cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię

Ad. 158. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

159. dot. pakietu Nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

4 ręczniki 30 x 40cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm

1 serweta dla noworodka 90 x 100cm z włókniny bawełnopodobnej absorbującej płyny

1 serweta do cięcia cesarskiego do zabiegów w pozycji pacjenta na wznak, 260/200 x 335cm z samoprzylepnym otworem wokół jamy brzusznej 27 x 33cm otoczonym folią chirurgiczną- rozmiar okna: 14 x 20cm ze zintegrowaną torbą na płyny 360 stopni i zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych? Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię (na Sali cięć cesarskich)

Ad. 159. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

160. dot. pakietu Nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

2 serwety samoprzylepne, dwuwarstwowe 75 x 90 cm

1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa, 175 x 180 cm

1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa, 150 x 240 cm? Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię

Ad. 160. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

161. dot. pakietu Nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

2 ręczniki 30 x 40cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm

3 serwety samoprzylepne (folia PE) 50 x 50cm

1 serweta do kraniotomii, 225 x 280cm z otworem 19 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów, z sitem i zaworem do podłączeniu drenu, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Ad. 161. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

162. dot. pakietu Nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

Serweta okulistyczna, 150 x 150cm z hydrofobowego (odpychającego płyny) materiału włókninowego z otworem umieszczonym centralnie 7 x 10cm ze zintegrowaną folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny 19 x 30cm

Ad. 162. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

163. dot. pakietu Nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

2 ręczniki 30 x 40cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm

1 serweta samoprzylepna dolna 190 x 225cm

1 serweta samoprzylepna górna 175 x 250cm z wycięciem „U” 10 x 65cm?

Ad. 163. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

164. dot. pakietu Nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, że wzmocnienie z laminatu dwuwarstwowego znajduje się wewnątrz fartucha i kończy 3 cm przed jego dolnym końcem, rękawy wszyte są prosto, kolor turkusowy, a rozmiar oznacza jednocześnie jego długość: 120 cm- rozm. M; 130cm- rozm. L; 150cm- rozm. XL; 170cm rozm. XXL i 150 L- rozmiar L dla operatorów o szerokich gabarytach? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Fartuchy były testowane w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskały pozytywną opinię.

Ad. 164. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

165. dot. pakietu Nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, że rękawy wszyte są prosto, kolor turkusowy, a rozmiar oznacza jednocześnie jego długość: 120 cm- rozm. M; 130cm- rozm. L; 150cm- rozm. XL; 170cm- rozm. XXL i 150 L- rozmiar L dla operatorów o szerokich gabarytach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Fartuchy były testowane w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskały pozytywną opinię.

Ad. 165. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

166. dot. pakietu Nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wym. 180 x 150cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 166. Zamawiający nie wyraża zgody

167. dot. pakietu Nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wym. 45 x 75 cm z otworem 6 cm? lub
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 6 cm?

Ad. 167. Zamawiający nie wyraża zgody

168. dot. pakietu Nr 22 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z samoprzylepnym otworem o średnicy 8 cm?

Ad. 168. Zamawiający nie wyraża zgody

169. dot. pakietu Nr 22 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wym. 180 x 150 cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 169. Zamawiający nie wyraża zgody

170. dot. pakietu Nr 22 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo złożonej w sposób umożliwiający jałową aplikację ze wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
lub
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo złożonej w sposób umożliwiający jałową aplikację? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 170. Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo złożonej w sposób umożliwiający jałową aplikację ze wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej przy zachowaniu wymaganego rozmiaru.

171. dot. pakietu Nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej o wym. 2 x 14,5 x 25,5 cm x 38 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 171. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

172. dot. pakietu Nr 23 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wym. 180 x 150 cm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 172. Zamawiający nie wyraża zgody

173. dot. pakietu Nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z tą

różnicą, że otwór ma średnicę 3 cm?

Ad. 173. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

174. dot. pakietu Nr 28 poz.7

Czy Zamawiający wydzieli tę pozycję do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Ad. 174. Zamawiający nie wyraża zgody

175. dot. pakietu Nr 29 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu spełniającego wszystkie wymagania SIWZ, jednak zawierającego dodatkowo:

1 x serweta o wymiarach 75x90 cm

10 x kompresów włókninowych 10 x10 cm a całość owinięta jest wewnątrz w papier krepowy?

Ad. 175. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

176. dot. pakietu Nr 31 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylne do szycia o następującym składzie:

1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm wzmocnienie 75x190 cm, owinięcie zestawu -1 szt
2. kleszczyki do materiałów opatrunkowych wykonane ze stali chirurgicznej 25 cm - 1 szt
3. tupfer z gazy z nitką RTG —4 szt
4. pojemnik miska) niebieska plastikowa, 250 ml - 2 szt
5. ręcznik 30 cm x 40 cm —2 szt
6. serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 180 cm, wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 —2 szt
7. serweta chirurgiczna o wymiarach 75 x 75 cm, wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 — 2 szt
8. kompres gazowy z nitką RTG, 12-warstwowy, 10x10cm —5 szt
9. ostrze z zabezpieczeniem nr 10 -1 szt.
10. ostrze z zabezpieczeniem nr 11- 1 szt
11. igła 0,80x40 mm-2 szt
12. strzykawka 20 ml dwuczęściowa - 1 szt

Składowe 1, 6 i 7 ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki (pozycja 1)

Składowe 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 umieszczone w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi.

Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zestaw wyposażony jest w dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zestaw zapakowany sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapą wykonaną z TYVEC-u w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania; przy zarzewie znajduje się sterylny margines

Ad. 176. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

177. dot. pakietu Nr 36 poz.2

Czy Zamawiający wymaga zgodności oferowanego ocieplacza z normą PN EN 13 795, która jest obowiązująca dla odzieży używanej w środowisku bloku operacyjnego? Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 do osobnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ocieplacza chirurgicznego spełniającego wymogi SIWZ, z tą różnicą, że czystość pod względem cząstek stałych wynosi $<3,4$ IPM, a pylenie wynosi $.3,2 \text{ Log}_{10}$ (liczba cząstek)?

Ad. 177. Zamawiający nie wydzieli pozycji Nr 2 do osobnego pakietu. Zamawiający dopuszcza zgodność wymienionej normy, ale nie żąda jej potwierdzenia dokumentem. Zamawiający dopuszcza ocieplacz chirurgiczny spełniający wymogi SIWZ, z tą różnicą, że czystość pod względem cząstek stałych wynosi $<3,4$ IPM, a pylenie wynosi $.3,2 \text{ Log}_{10}$ (liczba cząstek)