

Znak sprawy 11/2017

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017 r. pod numerem 2017/S 058-107532 na dostawę odzieży medycznej jednorazowego i wielorazowego użytku, obłożenia pola operacyjnego, serwet, osłon urządzeń medycznych, masek, czepków, obuwia operacyjnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 27.03.2017 - 11.04.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dotyczy pakietu Nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny polipropylenowego o gramaturze 20 g/m², z rękawem zakończonym bezlateksową gumką, rozmiar L / uniwersalny?

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający świadomie i z pełną odpowiedzialnością wymaga obuwia operacyjnego o obniżonych parametrach temp. Prania 90 st. C., gdy jest dostępne obuwie wytrzymałe na temp. sterylizacji 134 st.C. tańsze i wygodniejsze, z referencjami innych Szpitali, sprawdzone w wielu przetargach.
Obuwie takie jest dostępne nie tylko w naszej firmie, ponadto posiada certyfikat jednostki notyfikowanej, co gwarantuje najwyższą jakość potwierdzoną badaniami, a nie opinią przedstawiciela handlowego.

Ad. 2. Dopuszcza się obuwie wytrzymałe na temperaturę 134°C. Pozostałe wymogi SIWZ bez mian.

3. Proszę sprecyzować wymagane kolory obuwia oraz podać przybliżone ilości obuwia z kolorów .
Jest to informacja niezbędna wykonawcy do obliczenia kosztów postępowania, tym bardziej że termin dostawy jest kryterium wyboru oferty.
W obecnej postaci Zamawiający może zamówić w ciągu 24 mies. Np. 60 par koloru różowego w kropki, i wykonawca musi być na to gotowy.

Ad. 3. Zamawiający wymaga do wyboru 3 kolory jednolite.

4. dot. pakietu nr 19 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnej fartucha chirurgicznego ze wstawkami posiadającego w zestawie 2 ręczniki wiskozowe, wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z włókniny, odporność na rozrywanie na sucho 120kPa na mokro 122 kPa spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody

5. dot. pakietu nr 19 poz.2

Prosimy o dopuszczenie sterylne go fartucha chirurgicznego posiadającego w zestawie 2 ręczniki wiskozowe, wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z włókniny, odporność na rozrywanie na sucho 120kPa na mokro 122 kPa spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody

6. dot. pakietu Nr 19 poz.3

Prosimy o wydzielenie poz. 3 do odrębnego pakietu , co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców.

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody

7. dot. pakietu Nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga serwet składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka pakowane w worek foliowy po 10 szt.

Ad. 7. Zamawiający wymaga serwet składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka

8. dot. pakietu Nr 22 poz.2

Czy Zamawiający wymaga serwet składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka.

Ad. 8. Tak.

9. dot. pakietu Nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej dokumentu potwierdzającego elektrostatyczność włókniny z jakiej wykonana jest pościel

Ad. 9. Nie wymaga

10. dot. pakietu Nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka pakowane w worek foliowy po 10 szt.

Ad. 10. Wymagane jest jedynie składanie indywidualne pojedynczych sztuk.

11. dot. pakietu Nr 28

Czy Zamawiający wymaga, aby rozmiar obuwia był wytłoczony na jego pięcie co ułatwi łatwą identyfikację rozmiaru.

Ad. 11. Dopuszcza, ale nie wymaga (Nie jest to parametr istotny dla Zamawiającego)

12. dot. pakietu Nr 28

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obuwie posiadało anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz śródstopia oraz płaską podeszwę z dopuszczalnym prześwitem w części śródstopia nie wyższym niż 10 mm mierzonym od podeszwy do płaszczyzny styku obuwia z podłożem, oraz podniesionej części tylnej o wysokości nie mniejszej niż 30 mm, w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się?

Ad. 12. [Dopuszcza, ale nie wymaga](#)

13. dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 jednego z niżej opisanego zestawu?

Sterylna serweta przeznaczona do zabiegów na stawie kolanowym o wym.min.220 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w elastyczny otwór o średnicy 7cm, który szczelnie przylega powyżej kolana, dodatkowo osłona na kończynę o wym.min.33x65cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu oraz dwie taśmy lepne min.9x49cm do mocowania osłony kończyny. Całość owinięta w serwetę o wym.min.140x190cm, która służy jako przykrycie stolika -1 szt, 4szt ręczniki chłonne, - 1 x serweta Mayo min. 78x145 cm

Ad. 13. [Tak](#)

14. dotyczy Pakietu nr 3

Sterylna serweta przeznaczona do zabiegów na stawie kolanowym o wym.min.220 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w elastyczny otwór o średnicy 7cm, który szczelnie przylega powyżej kolana, dodatkowo osłona na kończynę o wym.min.22x75cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu oraz dwie taśmy lepne min.9x49cm do mocowania osłony kończyny. Całość owinięta w serwetę o wym.min.140x190cm, która służy jako przykrycie stolika - 2 szt., 4x ręczniki chłonne, - 1 x serweta Mayo min. 78x145 cm

Ad. 14. [Zamawiający nie wyraża zgody](#)

15. dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 niżej opisanego zestawu?

Sterylna serweta przeznaczona do zabiegu artroskopii kolana o wym.min. 200 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w 2 elastyczne otwory o średnicy 5cm, dodatkowo serweta zintegrowana jest z workiem przechwytyjącym płyny z filtrem i portem do odsysania i usztywnieniem. Dodatkowo osłona na kończynę o wym. 22 x 75cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu oraz dwie taśmy lepne o wym.min.9 x 49cm do mocowania osłony kończyny. Całość owinięta w serwetę o wym.min.140 x 180cm, która służy jako przykrycie stolika x 2 szt. (Dopuszcza się aby zestaw zawierał ręczniki chłonne).

Ad. 15. [Zamawiający nie wyraża zgody](#)

16. dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x180cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm

- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) z warstwą chłonną 25 x 60 cm
- 1 serweta 230x260cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) z warstwą chłonną 75 x 140 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

Materiał serwet 3-warstwowy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny o min. gramaturze 75 g/m² w części podstawowej. Gramatura łąty chłonnej min. 80 g/m². Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795.

Ad. 16. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

17. dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 niżej opisanego zestawu?

- 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
- 1 ręcznik do rąk – 100% celuloza
- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Ad. 17. [Tak](#)

18. dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Ad. 18. [Tak](#)

19. dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza

- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczo 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszeniami na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Ad. 19. Tak

20. dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 niżej opisanego zestawu?

- sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wym. 330 x 230 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, min. dwuwarstwowego, w części centralnej serwety otwór o wym. 36x36 cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór otoczony zintegrowanym z serwetą workiem z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny o wym. 72 x 72cm
- serweta-owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 75 cm x 120cm- 1szt.,
- pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach min. 78cm x 145 cm, ze wzmocnieniem 65x85- 1szt.
- taśma samoprzylepna 9cm x 50 cm- 1szt.,
- ściereczki chłonne –4 szt.,
- całość owinięta w serwetę o wym. 150 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika.

Ad. 20. Tak

21. dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz.2 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm). Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łąką chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łąka chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łąką chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łąka chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm), służąca jako owinięcie zestawu. Laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².

Materiał serwet głównych 3-warstwowy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny o gramaturze 75 g/m² w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m². Całkowita gramatura w strefie krytycznej 155g/m²
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.

Ad. 21. Nie

22. dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz.2 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), Laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną 25x60 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)służąca jako owinięcie zestawu. Laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².

Materiał serwet głównych 3-warstwowy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny o gramaturze 75 g/m² w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m². Całkowita gramatura w strefie krytycznej 155g/m²

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.

Ad. 22. Nie

23. dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 niżej opisanego zestawu?

- 1 ręcznik do rąk – 100% celuloza
- 1 serweta okulistyczna 150 x 140cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 8x10cm, dodatkowo torebka na płyny 30x20cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140cm
Laminat dwuwarstwowy o gramaturze 60g/m²

Ad. 23. Tak

24. dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 niżej opisanego zestawu?

1. serweta o wymiarach min.150x220 cm, z wycięciem w kształcie litery U, o wymiarach 6-20 cm x 50-100cm, wykończony taśmą samoprzylepną,
- 2.serweta o wymiarach min. 150x230 cm z taśmą lepną,
- 3.pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach min. 78 cmx 140 cm,
4. ściereczki chłonne - 4 szt,
- 5.tasma włókninowa, velcro lub spunlace o wymiarach min. 9x49 cm
6. serweta - owinięcie zestawu, służąca jako sterylne przykrycie stolika min.140x190cm
7. serweta o wymiarach 75x90m z taśmą lepną

Ad. 24. Tak

25. dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 poz. 1 niżej opisanego fartucha?

sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze min.35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40 g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 2,5 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: M,L, XL,XXL Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 200/200kPa

Ad. 25. Nie

26. dotyczy Pakietu nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 poz. 2 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy w strefie krytycznej szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch powinien charakteryzować się niskim poziomem pylenia 2,5 Log 10 (liczby cząstek). Rozmiar: M, L, XL, XXL do wyboru przez zamawiającego. Odporność na rozrywanie na sucho/mokro 200/200 kPa

Ad. 26. Nie

27. dotyczy Pakietu nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 poz. 3 niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch urologiczny 67g/m², rękawy wykonane z Laminatu: biała włóknina/folia PE 50g/m², oddychająca, w przedniej części Niebieska folia 40µm, w części tylnej hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Fartuch posiada kontrfałdy w części przedniej. Rozmiar XL – 150cm

Ad. 27. Nie

28. dotyczy Pakietu 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 20 poz. 1 serwety o wymiarach 50x60cm lub 75x90cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 28. Rozmiar 75x90cm mieści się w wymagach.

29. dotyczy Pakietu 20 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 20 poz. 2 i 3 serwety z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 29. Nie

30. dotyczy Pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 niżej opisanego zestawu?

- 1) serweta na stolik instrumentariuszki min. 140 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu - 1 szt.
- 2) serweta na stolik mayo min. 78 x 145 cm ze wzmocnieniem min 65 x 85 cm - 1 szt,
- 3) serweta do operacji kończyny o wymiarach min. 220x300 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze min. 57,5g/m², z samouszczelniającym się otworem o średnicy w zakresie 3 - 4 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, gramatura wzmocnienia 155 g/m² ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów - 1 szt.

Ad. 30. Tak

31. dotyczy Pakietu nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 25 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta do zaszywania 75 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm
- 1 serwetka dla dziecka 56 x 75 cm
- 6 ręczników do rąk 21 x 25 cm – 100% celuloza
- 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm

Ad. 31. Nie

32. dotyczy Pakietu nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 32 serwety z przylepcem na dłuższym boku, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 32. Tak

33. dotyczy Pakietu nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 33 serwety na stolik Mayo o wymiarach min 78x140cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 33. Tak

34. dotyczy Pakietu nr 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 23

Czy Zamawiający wymaga, aby serwety wchodzące w skład obłożeń, mające kontakt z pacjentem nie zawierały pyłacej i niebezpiecznej dla pacjenta celulozy?

Ad. 34. Dopuszcza, ale nie wymaga.

35. dotyczy sposobu pakowania

Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy obłożeń, fartuchy oraz serwety zapakowane były w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego?

Ad. 35. Dopuszcza, ale nie wymaga.

36. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, 5, 9, 12, 15 Pozycji 1 Ręczników do rąk 30x35 cm.

Ad. 36. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

37. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, 3, 9, 10, 34, 39 Pozycji 1 Serwety na stolik Mayo o wym. 80x140 cm.

Ad. 37. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

38. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, 5 Pozycji 1 Włókninowej taśmy medycznej 10x50 cm.

Ad. 38. Zamawiający nie wyraża zgody

39. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Pozycji 1 Osłony ortopedycznej o wymiarze 33x80 cm.

Ad. 39. Tak

40. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Pozycji 1 Serwety do artroskopii stawu barkowego, 200 x 320cm z elastycznym otworem 6x8 cm ze zintegrowaną torbą wyposażoną również w elastyczny otwór 6x8 cm na płyny, z zaworem do podłączenia drenu oraz z 4organizatorami przewodów i drenów.

Ad. 40. [Zamawiający nie wyraża zgody](#)

41. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, Pozycji 1 Serwety do zabiegów na stawie kolanowym o wym. 200 x 320cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 6x8 cm, który szczelnie przylega powyżej kolana.

Ad. 41. [Zamawiający nie wyraża zgody](#)

42. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 1 Serwety o wym. 200x290 cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. 9x105cm otoczonym taśmą samoprzylepną.

Ad. 42. [Zamawiający nie wyraża zgody](#)

43. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 1 Serwety o wym. 150x240cm, służącej jako ekran anestezjologiczny.

Ad. 43. [Zamawiający nie wyraża zgody](#)

44. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 1 Serwety na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu) min. 50 g/m².

Ad. 44. [Zamawiający nie wyraża zgody](#)

45. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 1 Serwety na stół Mayo 80 cm x 140 cm wykonanej z folii PE 0,07 mm i wzmocnionej laminatem dwuwarstwowym gramaturze min. 61 g/m², wielkość wzmocnienia min. 70 x 70 cm.

Ad. 45. [Zamawiający nie wyraża zgody](#)

46. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 1 Taśmy samoprzylepnej 10x50 cm.

Ad. 46. [Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

47. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 1Serwety operacyjnej wzmocnionej samoprzylepnej (ekran anestezjologiczny) 200 cm x 290 cm z wycięciem ""U"" 9x105 cm.

Ad. 47. [Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.](#)

48. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 1 Serwety operacyjnej wzmocnionej samoprzylepnej 200 cm x 290 cm z wycięciem ""U"" 9 cm x 105 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 61 g/m², łączna gramatura części podstawowej i krytycznej min. 110g/m².

Ad. 48. [Zamawiający nie wyraża zgody](#)

49. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 6, Pozycji 1 Sterylnej serwety do zabiegów P.C.N.L. o wym. 200x300cm wykonana z 2 warstwowego laminatu: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa. W części centralnej serwety znajduje się otwór min.15x20cm. Bezpośrednio pod otworem umocowany długi worek przechwytyjący płyny podczas zabiegu.

Ad. 49. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

50. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 7, Pozycji 1 Zestawu do zabiegów urologicznych o składzie:
1 x serweta do zabiegów urologicznych wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wym. 190x230cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na pręcie 5cm, otwór brzuszny przylepny 6 cm i osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Do obłożenia zamocowana jest torba przechwytyjąca płyny z sitem (filtrem) i podłączeniem drenu;
1 x serwetę o wym.150x200 cm, która może służyć jako przykrycie stolika (owinięcie zestawu);
1 x taśma przylepna 10x50 cm;
4 x ręcznik do rąk 30x30 cm.

Ad. 50. [Tak](#)

51. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 9, Pozycji 1 Kompresów gazowych 5x5 cm 8W, 17N.

Ad. 51. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

52. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 9, Pozycji 1 Rzepu o wymiarze 2,5x22 cm.

Ad. 52. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

53. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 9, Pozycji 1 Serwety ginekologicznej 200 x 265 cm, otwór przylepny 12 cm z zintegrowany workiem na płyny.

Ad. 53. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

54. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 9, Pozycji 1 Dwóch osłon na kończy 33x80 cm.

Ad. 54. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

55. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 10, Pozycji 1 Serwety głównej o wymiarach 240 x 330cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestetycznym, w części górnej wkomponowana folia operacyjna o wymiarach 30cm x 30cm, w części dolnej posiadająca otwór o wymiarach 10cm x 15cm wraz z przysłaniającą go klapą o wymiarach min.20cm x 20cm.

Ad. 55. [Tak, jeżeli pozostałe wymogi będą zgodne z SIWZ.](#)

56. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 12, Pozycji 1 Nożyczek chirurgicznych proste ostro/ tępe 13 cm do przecięcia pępownicy.

Ad. 56. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

57. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 12, Pozycji 1 Tupfer miękkie z gazy RTG, 50 x 50 cm, 17 nitek.

Ad. 57. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

58. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 12, Pozycji 1 Chusty z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy, 17 nitek.

Ad. 58. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

59. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 12, Pozycji 1 Serwety do cięcia cesarskiego 200x300 cm z torbą na płyny oraz oknem 25 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną (ułożenie płasko na stole).

Ad. 59. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

60. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14, Pozycji 2 Zestawu uniwersalnego wzmocnionego o składowe parametry:
1 x serweta górna (ekran anestetyczny) samoprzylepna, o wymiarach 160cm x 240 cm z organizatorem przewodów gramatura w miejscu warstwy chłonnej w strefie krytycznej min 150g/m² a jej odporność na wypychanie suchym/mokro min. 120 kPa;
1 x serweta dolna, samoprzylepna, z organizatorami przewodów, o wymiarach 160cm x 180 cm;
2 x serweta boczna, samoprzylepna na całej długości dłuższego boku, o wymiarach 80 cm x 100 cm wykonana z w całości z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m² i nieprzemakalności min. 950 cm H₂O;
1 x serweta dwuwarstwowa na stół min.150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna min. 28 g/m², folia PE min. 25 µm;
1 x serweta na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm z warstwą chłonną 60x140 cm, włóknina min. 36g/m², folia PE min. 0,07 mm;
1 x taśma lepna 10x50cm;

4 x ręczniki chłonne 30x30 cm.

Ad. 60. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

61. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 15, Pozycji 1 Serwety na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm z warstwą chłonną 60x140 cm, włóknina min. 36g/m², folia PE min. 0,07 mm.

Ad. 61. Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów

62. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 15, Pozycji 1 serwety głównej o wym. 200x280cm posiadająca otwór 22x22 cm wypełniony folią chirurgiczną, z warstwą chłonną i organizatorami przewodów oraz wyposażona dodatkowo w duży trójkątny worek do odprowadzania płynów.

Ad. 62. Nie

63. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 15, Pozycji 1 Taśmy lepnej 10x50cm, wykonany włókniny wodnoigłowanej składającej się w 51% z celulozy i 49% o gramaturze min. 60g/m².

Ad. 63. Nie

64. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16, Pozycji 1 Sterylnej serwety okulistycznej o wym. 120 x 160cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w otwór o wymiarach 10 x 10 cm wypełniony folią chirurgiczną. Dodatkowo kieszeń przylepna 25 x 26 cm do przechowywania płynów. Laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 61 g/m², nieprzemakalność 950 cm H₂O.

Ad. 64. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

65. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 17, Pozycji 1 Serwety o wymiarach 150x200 cm, z wycięciem w kształcie litery U, o wymiarach 6-10 cm x 50-65cm, wykończony taśmą samoprzylepną.

Ad. 65. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

66. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 17, Pozycji 1 Serwety o wymiarach 150x240 cm z taśmą lepną.

Ad. 66. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

67. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 18, Pozycji 1 Sterylnego pokrowca na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 14 x 250cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o grubości min. 0,04mm teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach.

Ad. 67. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

68. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 19, Pozycji 1 Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 28g/m² (rękawy szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu lub w postaci wszytej metki pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia <1,3 Log 10 (liczby cząstek). Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 160kPa. Rozmiar M, L, XL, XXL.

Ad. 68. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

69. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 19, Pozycji 2 Sterylnego fartucha chirurgicznego do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy i troki szyte techniką ultradźwiękową. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu lub w postaci wszytej metki pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia <1,3 Log 10 (liczby cząstek). Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 160 kPa. Rozmiar M, L, XL, XXL.

Ad. 69. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

70. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 19, Pozycji 3 Sterylny fartuch wykonany z włókniny typu Spunlacemin. 70 gr/m², wzmocniony laminatem PP/PE, nieprzemakalność min. 123 cm H₂O. Fartuch obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Rozmiar L, XL, XXL.

Ad. 70. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

71. Zwracamy się uprzejmie prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 19 Pozycji 3 do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru najatrakcyjniejszej oferty.

Ad. 71. [Nie](#)

72. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 20, Pozycji od 1 do 7 Serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze min. 54g/m².

Ad. 72. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

73. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 20, Pozycji 3 Serwety o wymiarze 75x100 cm z otworem 6x8 cm.

Ad. 73. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

74. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 20, Pozycji 2 Serwety o wymiarze 50x70 cm z otworem 6x8 cm.

Ad. 74. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

75. Zwracamy się uprzejma prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 21 Pozycji 2 do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru najatrakcyjniejszej oferty.

Ad. 75. Nie

76. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 23, Pozycji 1 Serwety do operacji kończyny o wymiarach 200x300 cm wykonanej z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze min. 61g/m², z samouszczelniającym się otworem o średnicy w zakresie 3 - 4 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej o łącznej gramaturze(wzmocnienia i części podstawowej)min. 115 g/m² ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Ad. 76. Tak, jeżeli pozostały skład i parametry jest zgodny z SIWZ.

77. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 25, Pozycji 1 Serwety pod pośladki z torbą na płyny o całkowitym rozmiarze min. 120x100cm.

Ad. 77. Zamawiający wymaga rozmiaru min. 90x92cm. Każdy większy spełnia wymagania, jeżeli zachowane są pozostałe parametry.

78. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 27, Pozycji 1 Zestawu do szycia o składzie :

- 1 x Serweta wzmocniona na stół instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiarze 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 65cm x 190 cm;
- 1 x Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24 cm, niebieskie;
- 4 x Tupfer fasolka z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany z gazy o wymiarach 30 cm x 30 cm);
- 2 x Pojemnik plastikowy przezroczysty, z podziałką 250 ml;
- 4 x Ściereczki poliestrowo - celulozowe 30 cm x 35 cm;

2 x Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 200 cm x 150 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.54g/m²;
2 x Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 100 cm x 75 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.54g/m²;
5 x Kompresy gazowe 17N, 8W z nitką RTG, 10 cm x 10 cm;
1 x Ostrze nr 10 wraz z zabezpieczeniem;
1 x Ostrze nr 11 wraz z zabezpieczeniem;
1 x Igła 0,8 x 40 mm;
1 x Strzykawka 20 ml dwuczęściowa.

Ad. 78. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

79. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 32, Pozycji 1 Serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54g/m². Pozostałe parametry spełnione.

Ad. 79. Tak

80. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 34, Pozycji 1 Serwety 240x325 cm z przylepnym otworem 30x30cm ze zintegrowanymi nogawicami. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 61g/m² na całej powierzchni okrywającej pacjenta. Odporność na przenikanie płynów min.960 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho min 150kPa.

Ad. 80. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

81. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 35, Pozycji 3 Tupferów w kształcie fasolki.

Ad. 81. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

82. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 35, Pozycji 1 miseczki 250 ml o wielkości min. 9 x5,5 cm.

Ad. 82. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

83. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 35, Pozycji 1 i 2 miseczki 500 ml o wielkości min. 11 x7,5 cm.

Ad. 83. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

84. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 35, Pozycji 2 miski 2500 ml o wielkości min. 21,5 x8cm.

Ad. 84. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

85. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 35, Pozycji 1 i 2 Serwety (owinięcie zestawu) o wymiarze 75x100 cm.

Ad. 85. Tak

86. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 41, Pozycji 1 Fartucha higienicznego wykonanego z włókniny spunbond, min. gramatura 25g/m², stanowiący barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznym mankietem, posiadający przedłużone poły, do zakładania na plecach, nietoksyczny, niepalący się.

Ad. 86. Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ

87. dot. (pakiet nr 16)

Czy Zamawiający dopuści serwetę 100 x 100cm o gramaturze 48 g/m² oraz kieszeń przylepną o wymiarach 22 x 29cm?

Ad. 87. Nie

88. dot. (pakiet nr 16)

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Ad. 88. Nie

89. dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów na stawie kolanowym o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw chirurgiczny do chirurgii kończyny dolnej - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x320cm z samouszczelniającym się owalnym otworem, z uchwytem („rzepem”) do mocowania kabli i drenów
- 1 serweta o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 89. [Tak](#)

90. dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegu artroskopii kolana o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca elastometryczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastometrycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 90. [Tak](#)

91. dotyczy Pakietu 5

Zwracamy się z wyjaśnieniem czy Zamawiający w Pakiecie zawarł dwa opisy obłożeń?

Ad. 91. [Nie](#)

92. dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i

datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 92. [Nie](#)

93. dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów P.C.N.L. o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw do PCNL (endoskopowy/przezskórny zabieg usunięcia kamieni z wnętrza nerki)– serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 56 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 285 cm H₂O, odporność na rozrywanie – min. 315 kPa.
Skład :
- 1 serweta do PCNL 200x300cm z otworem samoprzylepnym 20x23 cm i workiem do zbierania płynów **60x120cm**
- serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.
Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 93. [Tak](#)

94. dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do przezcewkowych zabiegów urologicznych o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.
Skład :
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłonę na palec
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 94. [Tak](#)

95. dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych I - serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,
- 1 serweta główna wzmocniona o min. wym. 290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem
- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przezroczystego PE
- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 95. Tak

96. dotyczy Pakietu 10

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczywych o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw brzuszno – kroczyowy_ - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna – przylepne i okolice krocza - nieprzylepne okno oraz 3. uchwyty do mocowania kabli i drenów
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 96. Nie

97. dotyczy Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia III (pozycja

leżąca) - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem wypełnionym w 100% folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 97. Tak

98. dotyczy Pakietu 14 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw podstawowy_- serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 98. Nie

99. dotyczy Pakietu 14 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony_- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną

typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 99. Nie

100. dotyczy Pakietu 19 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji wzmocnionego jednorazowego jałowego fartucha operacyjnego do operacji mokrych, wykonany z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące ucisku na skórę, podwójny szew na rękawach, rękawy szerokie, zapewniające swobodę ruchów; Fartuch o gramaturze min. 35g/m² w części podstawowej. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze min. 40g/m². Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dł. min 6cm. Fartuch zapinany na szyi na rzep. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem (troki fartucha szyte szwem ultradźwiękowym) . Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora przy zakładaniu. Fartuch pakowany z dwoma ściereczkami do wycierania rąk. Fartuch i ręczniki owinięte w ochronną serwetę włókninową. Etykieta produktu w języku polskim, posiadająca dwie repozycjonowalne wklejki z oznaczeniem producenta, numerem katalogowym produktu, numerem lot i datą ważności (dwie etykiety dodatkowo z kodem kreskowym). Minimalne parametry wytrzymałości:

Odporność na rozerwanie na mokro min. 140 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na rozerwanie na sucho min. 150 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na penetrację płynów min. 215 cm H₂O dla pow. Krytycznej

Niski poziom pylenia 2,5 log 10 (liczby cząstek)

Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha w postaci wszywki

Fartuch spełniający wymogi jakościowe Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie działania w obszarze krytycznym. Oferowane fartuchy muszą być pakowane w kopertę papierowo-foliową, a następnie w karton dodatkowo owinięty folią (opakowanie pośrednie). Rozmiary M, L, XL, XXL.

Ad. 100. Nie

101. dotyczy Pakietu 19 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w tej pozycji Fartucha chirurgicznego jednorazowego, jałowego z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS o gramaturze

35g/m². Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dł. min 6cm. Fartuch zapinany na szyi na rzep. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem (troki fartucha szyte szwem ultradźwiękowym). Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora przy zakładaniu. Fartuch pakowany z dwoma ściereczkami do wycierania rąk. Fartuch i ręczniki owinięte w ochronną serwetę włókninową. Etykieta produktu w języku polskim, posiadająca dwie repozycjonowalne wklejki z oznaczeniem producenta, numerem katalogowym produktu, numerem lot i datą ważności (dwie etykiety z kodem kreskowym). Parametry wytrzymałości:
Odporność na rozerwanie na mokro min. 130 kPa dla pow. krytycznej
Odporność na rozerwanie na sucho min. 140 kPa dla pow. krytycznej
Odporność na penetrację płynów min. 40 cm H₂O.
Niski poziom pylenia 2,5 log 10 (liczby cząstek)
Fartuch spełniający wymogi jakościowe Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie działania w obszarze krytycznym. Fartuchy pakowane w kopertę papierowo-foliową, a następnie w karton dodatkowo owinięty folią (opakowanie pośrednie). Rozmiary M, L, XL, XXL.

Ad. 101. [Nie](#)

102. dotyczy Pakietu 19 poz.3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z pakietu i utworzenie odrębnego zadania?

Ad. 102. [Nie](#)

103. dotyczy Pakietu 22 poz.1-3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-3 z pakietu i utworzenie odrębnego zadania?

Ad. 103. [Nie](#)

104. dotyczy Pakietu 23

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do operacji dłoni / stopy o następującym składzie i parametrach: Jałowy zestaw do chirurgii dłoni/ stopy_- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m²
Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy 220 x 320 cm z elastycznym otworem i zintegrowanym uchwytem na dreny
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z

normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011, EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Ad. 104. [Nie, Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ](#)

105. dotyczy Pakietu 26

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koszuli niejałowej, nieprzejrystej w kolorze ciemnoniebieskim o długości min.106cm?

Ad. 105. [Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów](#)

106. dotyczy Pakietu 36

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompletu pościeli medycznej o gramaturze 20g/m2?

Ad. 106. [Nie](#)

107. dotyczy Pakietu 38

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ubrania chirurgicznego w jednym kolorze niebieskim?

Ad. 107. [Nie](#)

108. dotyczy Pakietu 41

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha higienicznego wykonanego z włókniny o gramaturze 24g/m2 w rozmiarze XL – będącym uniwersalnym dla większości użytkowników?

Ad. 108. [Zamawiający dopuszcza gramaturę 24g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów.](#)

109. dot. Pakietu 19, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Wyłączenie ww. pozycji z pakietu zwiększy zatem konkurencyjność przetargu, a tym samym możliwość wyboru oferty optymalnej dla Zamawiającego. Będzie więc zgodna z zasadą uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 109. [Nie](#)

110. dot. Pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem elastycznym o śr. 6cm i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	320x240
pokrowiec na kończynę górną pacjenta	1	75x37
serweta pod kończynę z przylepcem	1	90x75

taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	4	40x20

Ad. 110. [Nie](#)

111. dot. Pakietu 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem elastycznym o śr. 6cm i workiem z kształtką do zbierania płynów (wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m ²)	1	320x240
pokrowiec na nogę	1	75x37
taśma medyczna	2	50x9
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20

Ad. 111. [Nie](#)

112. dot. Pakietu 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem elastycznym o śr. 6 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów (wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m ²)	1	320x240
pokrowiec na nogę	1	75x37
taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20

Ad. 112. [Tak](#)

113. dot. Pakietu 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem 22x15cm, przylepcem i kieszenią na płyny z kształtką (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²)	1	300x180
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150

Ad. 113. [Tak](#)

114. dot. Pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
-------	-------	---------

serweta z otworem elastycznym o śr. 5cm, ochroniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami (wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2)	1	215x180
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20
taśma medyczna	1	50x9

Ad. 114. [Tak](#)

115. dot. Pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem elastycznym o śr. 5cm, ochroniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami (wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2)	1	215x180
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20
taśma medyczna	1	50x9

Ad. 115. [Tak](#)

116. dot. Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folią chirurgiczną, w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m2)	1	260x240
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75
taśma medyczna	1	50x9
kieszeń na płyny	1	42x35
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	4	40x20

Ad. 116. [Tak](#)

117. dot. Pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem 32x35cm, z workiem, folią chirurgiczną z wycięciem (wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m2)	1	320x180
serweta z włókniny kompresowej	1	80x60
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80

serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20
---	---	-------

Ad. 117. Nie

118. dot. Pakietu 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20

Serwety obłożeniowe wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2 na całej powierzchni.

Ad. 118. Nie

119. dot. Pakietu 14, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stolik 190x150cm wykonana z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej, o łącznej gramaturze min. 84g/m2, chłonność 400% (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo 145x80cm, niebieska wykonana z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej, o łącznej gramaturze min. 74g/m2, barierowość dla wody min. 123 cm H2O	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	4	40x20

Serwety obłożeniowe wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73g/m2 na całej powierzchni, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 150 kPa oraz dodatkowo osobno dostarczana taśma mocująca typu rzep w rozm. 25x2cm?

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Ad. 119. Nie

120. dot. Pakietu 15, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z otworem 25x20cm, z workiem na płyny i folią chirurgiczną (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m2)	1	240x200

serweta z przylepcem (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²)	2	60x50
Serveta (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²)	2	90x75
kieszon dwukomorowa z kształtką	2	42x35
kieszon na płyny z kształtką	2	40x30
taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół 190x150cm wykonana z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej, o łącznej gramaturze min. 84g/m ² , chłonność 400% (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stół Mayo 145x80cm, wykonana z folii polietylenowej i polipropylenowej warstwy chłonnej w rozmiarze 85x76cm, o łącznej gramaturze min. 74g/m ² , barierowość dla wody min. 123 cm H ₂ O	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	4	40x20

Ad. 120. Nie

121. dot. Pakietu 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z wycięciem "U" 63x7cm i przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	240x180
serweta na stół instrumentariuszki	1	190x150
serweta na stół Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20
taśma medyczna	1	50x9

Ad. 121. Tak

122. dot. Pakietu 19, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej fartucha ze wstawkami do długich procedur, wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wyposażony z nieprzemakalnymi wstawkami z przodu i na rękawach umieszczone od zewnętrznej strony fartucha i wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40g/m² na przodzie i rękawach, łącznie elementów fartucha szwem ultradźwiękowym – dzięki czemu zachowuje pełną barierowość. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem – troki wgrzane ultradźwiękowo, z tyłu zapinanie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju fartucha, zabezpieczenia oraz normy EN 13795 w postaci wszywki widocznej przy złożonym fartuchu, co pozwala na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwoma etykietami przylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru krepowanego, dodatkowo pakowany z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia: w strefie krytycznej 1,2 log 10 i w mniej krytycznej 1,6 log 10. Dostępny w rozmiarze M-XXL. Wytrzymałość na rozciąganie w strefie krytycznej wzdłuż na sucho/mokro 143,9/153,7 N. Odporność na wypychanie na sucho/mokro: w strefie krytycznej 65,9/64,8 kPa, w strefie mniej krytycznej 52,1 kPa.

Ad. 122. Nie

123. dot. Pakiet 19, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej fartucha chirurgicznego do procedur standardowych, wykonanego z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem – troki wgrzane ultradźwiękowo, z tyłu zapięcie na rzep. Łącznie elementów fartucha szwem ultradźwiękowym – dzięki czemu zachowuje pełną barierowość. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju fartucha, zabezpieczenia oraz normy EN 13795 w postaci wszynki widoczne przy złożonym fartuchu, co pozwala na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. dwoma etykietami przylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru krepowanego, dodatkowo pakowany z dwoma ręcznikami z włókniny kompresowej do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 1,22 log 10. Dostępny w rozm. M-XXL. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na sucho/mokro 77,8/82,3 N. Odporność na wypychanie na sucho/mokro 45,8 / 43,5 kPa.

Ad. 123. [Nie](#)

124. dot. Pakietu 20

Czy Zamawiający ma na myśli serwety jałowe?

Ad. 124. [Tak](#)

125. dot. Pakietu 20, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 8cm lub 8x6cm?

Ad. 125. [Nie](#)

126. dot. Pakietu 23, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z elementem elastycznym i otworem o śr. 4cm (wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ² na całej powierzchni)	1	300x240
serweta na stół instrumentariuszki (jako owinięcie zestawu)	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	4	40x20

Ad. 126. [Nie](#)

127. dot. Pakietu 32, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 150x180cm?

Ad. 127. [Nie](#)

128. dot. Pakietu 35, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyłącznie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Ad. 128. [Nie](#)

129. dot. Pakietu 35, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami gazowymi?

Ad. 129. [Tak](#)

130. dot. Pakietu 36, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli w kolorze niebieskim?

Ad. 130. [Tak](#)

131. dot. Pakietu 41, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m² z rękawami wykończonymi elastyczną nieuciskającą gumką?

Ad. 131. [Nie](#)

132. dot. Pakietu 41, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha higienicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m²?

Ad. 132. [Nie](#)

133. dot. zapisu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 133. [Tak](#)

134. dot. zapisu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy zdanie drugie otrzymało następującą treść „*W przypadku, gdy do dostawy wraz z fakturą dołączony będzie dokument WZ wówczas Zamawiający dopuszcza zamiast na fakturze - umieszczenie serii / daty ważności / numeru umowy na dokumencie WZ.*”?

Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, numer serii dostarczonego towaru nie musi być zamieszczony na fakturze. Dlatego umieszczenie na dokumencie WZ zamiast na fakturze powinno być dopuszczalne nie tylko w przypadku daty ważności i numeru umowy, ale również w przypadku numeru serii.

Ad. 134. [Zamawiający nie wyraża zgody.](#)

135. dot. zapisu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „1% wartości brutto danego zamówienia” zostało zastąpione wyrażeniem „1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby zwłoka w dostawie dotyczyła tylko części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 135. Zamawiający nie wyraża zgody

136. dot. zapisu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, *„kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”* Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając *„uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”*

Ad. 136. Zamawiający nie wyraża zgody

137. dot. zapisu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”*?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Ad. 137. Zamawiający nie wyraża zgody

138. dot. Pakietu29 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwośluzowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniyny polipropylenowej,

absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35ml/100cm², rozmiarze min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu. Warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z folii teksturowanej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, którą chroni.

Ad. 138. Nie

139. dot. Pakietu 29 poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.2 z Pakietu nr 29 i utworzenie nowego Pakietu, np. 29A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Ad. 139. Nie

140. dot. Pakietu 29 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na podłokietniki o wymiarach 31,5cmx71cm +/-2cm pakowanych po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem

Ad. 140. Zamawiający dopuszcza osłony na podłokietniki o wymiarach 31,5cmx71cm +/-2cm

141. dot. Pakietu 29 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej lepszej chłonności płynów niż opisana tj. 3l/m² w rozmiarze 71x101 cm .

Mata posiada foliowy, antypoślizgowy spód zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze.

Ad. 141. Nie

142. dot. Pakietu nr 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii barku z torbą na płyny o następującym składzie:

- Osłona na stół narzędziowy 152x190cm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem
- 4 ręczniki do rąk 34x36cm, rozłożone
- 1 serweta SMMMS do operacji barku 254x168cm z przylepnym otworem z wycięciem na bark oraz folią operacyjną, torba na płyny z 2 portami wyjściowymi, 3 uchwyty na przewody typu rzep
- 1 serweta SMMMS do operacji barku typu U na ciało 196x290cm z przylepnym wycięciem 25x63cm, wzmocnienie chłonne 99x102cm, 2 uchwyty na przewody typu rzep
- osłona na kończynę 23x91cm, sterylna, pakowana osobno

Ad. 142. Tak

143. dot. Pakietu nr 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na stawie kolanowym o następującym składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm

- 1 x serweta na stół Mayo 142x80 cm ortopedyczna
- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
 - 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów

Ad. 143. [Tak](#)

144. dot. Pakietu nr 3 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o środowisko naturalne zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów posiadających certyfikat ISO 14001, który odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta w sposób wszechstronny, systematyczny, planowy i udokumentowany sposób. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Cele systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Ad. 144. [Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.](#)

145. dot. Pakietu nr 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na stawie kolanowym o następującym składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo min. 77 x 142 cm
- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm

Ad. 145. [Nie](#)

146. dot. Pakietu nr 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na stawie kolanowym o następującym składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm
- 1 x osłona na stół Mayo ortopedyczna 80x142 cm
- 1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa,
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z taśmą samoprzylepną,
- 1 x serweta do artroskopii w 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.

Ad. 146. [Nie](#)

147. dot. Pakietu nr 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na stawie kolanowym o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo min. 77x142cm,
- 1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów

Ad. 147. [Nie](#)

148. dot. Pakietu nr 5 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

- osłona na stół narzędziowy 140x190cm, gramatura min. 77g/m², (opakowanie wewnętrzne)
 - 1 przylepna serweta górna z trilaminatu 254x183cm, wzmocnienie na obszarze 67x39cm,
 - 1 uchwyt na przewody
 - 1 serweta U z trilaminatu 196x305cm, wzmocnienie na obszarze 77x119cm, przylepne wycięcie 15x117cm, 2 uchwyty na przewody
 - 1 serweta pomocnicza z trilaminatu 98x98cm
 - 2 taśmy lepne 9x50cm
 - 2 ręczniki chłonne 30x20cm rozłożone
 - 1 nieprzepuszczalna stokineta 30x122cm
 - 1 osłona na stół narzędziowy 140x190cm, gramatura min. 77g/m², złożona
 - 1 osłona ortopedyczna na stół Mayo 80x145cm, gramatura min. 95g/m², wzmocnienie chłonne wysokiej wytrzymałości (wiskoza + polietylen) na obszarze 75x100cm
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m², ze wzmocnieniem chłonnym, o łącznej gramaturze materiału 144g/m²

Ad. 148. [Tak](#)

149. dot. Pakietu nr 7 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do przezcewkowych zabiegów urologicznych o następującym składzie:

- 1x serweta na stół narzędziowy 140x190cm (opakowanie wewnętrzne)
- 2x ręcznik chłonny 30x20cm
- 1xtaśma lepna 9x50cm
- 1x serweta główna 290/175x242cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzuszny fi 8cm, z otworem na pręcie fi 5cm, osłona na palec, z torba na płyny z filtrem i portem do ssaka oraz 2 trokami

Ad. 149. [Tak](#)

150. dot. Pakietu nr 8 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia ginekologicznego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230 cm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 x serweta litotomijna 137/74x192cm z osłoną ramion stołu, z nieprzylepnym otworem kroczyowym 6x15cm, wzmocnieniem chłonnym 49x31 cm wokół otworu operacyjnego, paskiem przylepnym do fiksacji serwety na spojeniu łonowym
- 1 x serweta 45x50cm przylepna
- 2 x nogawice SMMMS 79x140cm
- 1 x ręcznik chłonny 58x39cm (11x16cm po złożeniu)

Ad. 150. Nie

151. dot. Pakietu nr 8 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia ginekologicznego o następującym składzie:

- Osłona stolik narzędziowy 125x230 cm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 przylepna serweta z trilaminatu 98x142 cm
- 2 nogawice SMMMS 79x140cm
- 1 ręcznik do rąk 58x39 cm rozłożony
- 1 serweta pod pośladki 96x126 cm
- 1 przylepna serweta mała z bilaminatu 45x50 cm

Ad. 151. Nie

152. dot. Pakietu nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105cm wykonany z materiału Spunlace (sztuczny jedwab+poliester)
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie .

Ad. 152. Nie

153. dot. Pakietu nr 11

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, iż serweta do cięcia cesarskiego będzie w kształcie litery T, dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestezjologicznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Ad. 153. Dopuszcza, ale nie wymaga

154. dot. Pakietu nr 11

Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki Zamawiający oczekuje, aby serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki)?

Ad. 154. [Dopuszcza, ale nie wymaga](#)

155. dot. Pakietu nr 14 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo min. 77x142 cm
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z bilaminatu (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 58g/m², bez dodatkowych wzmocnień.

Ad. 155. [Nie](#)

156. dot. Pakietu nr 14 poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby materiał z którego wykonane są serwety okrywające pacjenta charakteryzował się odpornością na penetrację płynów >200cmH₂O.

Ad. 156. [Dopuszcza, ale nie wymaga](#)

157. dot. Pakietu nr 14 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu), wykonana z folii PE o grubości min. 50µm, wzmocniona, gramatura min. 76g/m², zdolność absorpcji 580%
- 1x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm, grubość min.75 µm z warstwą chłonną 55x88cm, gramatura min. 95g/m²
- 2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta 196x 200 cm, przylepna
- 1 x serweta 160x260 cm, przylepna
- 1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z trójwarstwowego chłonnego materiału na całej powierzchni (bez dodatkowych wzmocnień) o gramaturze 66g/m², barierowego dla cieczy spełniającego na całej powierzchni wymagania wysokie dla strefy krytycznej. Odporność na penetrację płynów min. 200cmH₂O, wytrzymałość na rozzerwanie na sucho i mokro min. 200kPA.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Ad. 157. [Nie](#)

158. dot. Pakietu nr 14 poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby serwety okrywające pacjenta wykonane były z materiału jednorodnego na całej powierzchni.

Ad. 158. [Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.](#)

159. dot. Pakietu nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu sterylnego do zabiegów laryngologicznych o następującym składzie:

- Ośłona na stół narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta typu U z trilaminatu 196x279cm, przylepne wycięcie 6x63cm, wzmocnienie 43x51cm, podkład pod narzędzia 25x46cm, 2 uchwyty na przewody
- 1 przylepna serweta turban z trilaminatu 107x82,5cm
- 1 osłona na stół Mayo 80x142cm

Ad. 159. [Nie](#)

160. dot. Pakietu nr 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji dłoni/stopy o następującym składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm ze wzmocnieniem 55x88cm
- 1 x serweta 75x75 cm, przylepna
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,

Serwety okrywające pacjenta wykonane z bilaminatu (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 58g/m², bez dodatkowych wzmocnień.

Ad. 160. [Nie](#)

161. dot. Pakietu nr 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji dłoni/stopy o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm
- 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm
- 1x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem fi 5cm
- serweta na stół Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem 55x88cm, sterylna, pakowana osobno

Serwety okrywające pacjenta wykonane z trójwarstwowego chłonnego materiału na całej powierzchni (bez dodatkowych wzmocnień) o gramaturze 66g/m².

Ad. 161. Nie

162. dot. Pakietu nr 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do porodu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 2 x nogawice 79x 140 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny XL, 130 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta pod pośladki z folii PE 85x114,5 cm, ze wzmocnieniem 32,5x50 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, z portem do ssaka
- 1 x serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonane z laminatu 2-warstwowego.

Ad. 162. Nie

163. dot. Pakietu nr 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x196cm.

Ad. 163. Nie

164. dot. Pakietu nr 33

Prosimy o dopuszczenie lepszego, bezpieczniejszego i wygodniejszego niż teleskopowy sposobu składania serwety na stolik Mayo, który gwarantuje bezpieczny, stopniowy i aseptyczny sposób aplikacji na stolik MAYO bez ryzyka jej zbrudzenia (rewersowego). Państwa zgoda podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert.

Ad. 164. Dopuszcza się proponowany rodzaj składania serwety przy zachowaniu pozostałych parametrów.

165. dot. Pakietu nr 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cholecystektomii laparoskopowej, w składzie którego serwety charakteryzują się wytrzymałością na rozerwanie na mokro/sucho min. 190kPa.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Ad. 165. Tak

166. dot. Pakietu nr 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego o rozmiarze 58x91cm o chłonności 750-850g.

Ad. 166. Tak

167. dot. Pakietu nr 41

Prosimy o dopuszczenie fartucha higienicznego z rękawami zakończonymi gumkami. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Ad. 167. [Nie](#)

168. dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, który zawiera 1 taśmę samoprzylepną a osłona na kończynę ma wymiar 33 x 55 cm?

Ad. 168. [Tak](#)

169. dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, który zawiera 1 taśmę samoprzylepną a osłona na kończynę ma wymiar 33 x 55 cm ?
Dodatkowo w zestawie znajduje się serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm oraz serweta z laminatu dwuwarstwowego 150 x 180 cm służąca do okrycia kończyny nieoperowanej?

Ad. 169. [Tak](#)

170. dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ z drobnymi różnicami:

Skład:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm – gramatura serwety min. 76 g/m²
 - 4 x ręcznik do rąk
 - 1 x serweta na stolik Mayo (specjal do zabiegów ortopedycznych) wzmocnienie 75 x 90 cm, materiał wzmocnienia laminat dwuwarstwowy- gramatura całej serwety 130,5 g/m²
 - 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
 - 1 x serweta operacyjna samoprzylepna 75 x 90 cm
 - 1 x serweta nieprzylepna 150 x 180 cm
 - 1 x osłona ortopedyczna z laminatu dwuwarstwowego 33 x 110 cm
 - 2 x taśmy lepne foliowe 10 x 50 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna – ekran anestetyczny 225 x 270 cm z wycięciem i osłoną podpórek kończyn górnych
 - 1 x serweta samoprzylepna- dolna 280 x 225 cm z wycięciem "U" 10 x 100 cm?
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 170. [Tak](#)

171. dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ z następującymi różnicami:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
 - 1 x serweta do procedur urologicznych 225/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami kończyn dolnych, z otworem w okolicy odbytu 5 cm, z otworem nadłonowym 8 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z bezlateksową osłoną na palec;
 - 1 x uchwyt na rzep do drenów typu Velcro
 - 2 x ręcznik do rąk?
- Serweta główna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m² na całej powierzchni.

Ad. 171. [Tak](#)

172. dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z tą różnicą, iż serweta ginekologiczna 175/260 x 210 cm oraz zestaw dodatkowo zawiera serwetę samoprzylepną do oklejenia krocza 50 x 50 cm oraz 2 ręczniki do rąk?

Ad. 172. [Tak](#)

173. dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z następującymi różnicami:

- serweta ginekologiczna ma wymiar 240/260 x 230 cm wbudowane osłony na kończyny dolne, samoprzylepny otwór 10 x 15 cm, wzmocnienie chłonne wokół otworu oraz wbudowany worek do zbiórki płynów;
- kompresy gazowe mają nitkę RTG
- uchwyt velcro ma wymiar 2,5x20/24 cm

Czy dla weryfikacji składu zestawu i jakości komponentów Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbki niesterylnej?

Ad. 173. [Nie](#)

174. dot. Pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym:

- serweta główna w części brzusznej posiada otwór o wymiarach 28 x 32 cm, a w części dolnej otwór o wymiarach 10 x 15 cm przesłonięty klapką,
 - taśma lepna ma wymiar 9 x 25 cm;
 - serweta na stolik instrumentalny ma wymiar 150 x 190 cm
- a kieszeń samoprzylepna 38 x 40 cm oraz z serweta pod pacjenta będą pakowane osobno?

Ad. 174. [Nie](#)

175. dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym:

- serweta główna ma otwór 27 x 33 cm wypełniony folią chirurgiczną i worek do zbiórki płynów, a górna jej część w obszarze ekranu anestetycznego jest zbudowana z folii PE

Taśmy samoprzylepna będzie pakowana osobno?

Ad. 175. [Nie](#)

176. dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia zgodnego z SIWZ, z następującymi różnicami:

- serweta do cesarskiego cięcia z torbą na płyny ma wymiar 260/200 x 335 cm i posiada zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych oraz samoprzylepny otwór 27 x 33 cm otoczony folią chirurgiczną (wymiar okna 14 x 20)
- ręcznik celulozowy ma wymiar 30 x 40cm

- serwety gazowe 45 x 45 cm zostały poddane wstępnemu praniu i mają wymiar 40 x 40 cm
- tupfery miękkie z gazy 20N z RTG mają wykrój 44,5 x 44,5 cm
- nożyczki do przecięcia pępowiny mają długość 16,5 cm?

Ad. 176. Nie

177. dot. Pakietu 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m² na całej powierzchni, w którym taśma 9 x 50 cm będzie pakowana osobno?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu.

Ad. 177. Nie

178. dot. Pakietu 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m² na całej powierzchni dodatkowo wzmacnianego w polu krytycznym łatami chłonnymi- łączna gramatura w polu operacyjnym (laminat plus wzmocnienie min. 109,5 g/m²) o następujących wymiarach i składzie:

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm o gramaturze min. 76 g/m² i poziomie absorpcji cieczy 100% (badanie wg EN ISO 9073-6) i wzmocnieniem o wymiarach 75 x 190 cm

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm- wzmocnienie 75 x 90 cm

4x ręcznik do rąk

1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

1x serweta ekran anestezyjologiczny 150 x 250 cm z organizatorami przewodów – wzmocnienie o wymiarach 20 x 50 cm (+/- 0,5 cm)

2 x serwety boczne 75 x 90 cm- wzmocnienie o wymiarach 20 x 50 cm (+/- 0,5 cm)

1x serweta dolna 175 x 180 cm- wzmocnienie o wymiarach 20 x 50 cm (+/- 0,5 cm)

Odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio 250/ 270 kPa;

Zdolność absorpcji cieczy 405 ml/m² (badanie wg EN ISO 9073-6)?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu

Ad. 178. Nie

179. dot. Pakietu 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii o następującym składzie:

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm z folii polietylenowej wzmocnionej włókniną o wymiarach 75 x 190 cm

2x ręcznik do rąk 30 x 40 cm

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym 75 x 90 cm o łącznej gramaturze 83 g/m², z dużym wywinięciem

3x serweta samoprzylepna z folii PE 50 x 50 cm

1x serweta do zabiegów kraniotomii 225 x 280 cm z otworem 19 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem 270 stopni, z sitem i zaworem do podłączenia drenu, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

1x kieszeń jednokomorowa 38 x 40 cm – pakowana osobno,

1x kieszeń dwukomorowa 38 x 40 cm – pakowana osobno?

Ad. 179. Nie

180. dot. Pakietu 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej 150 x 150 cm wykonanej z hydrofobowej włókniny spunlace o gramaturze 68 g/m² z otworem w części centralnej 7 x 10 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz zintegrowanym workiem/ kieszenią do zbiórki płynów o wymiarach 19 x 30 cm?

Ad. 180. Tak

181. dot. Pakietu 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym serweta dolna ma wymiar 190 x 225 cm, zestaw nie zawiera taśmy ani velcro? Czy Zamawiający oczekuje taśmy włókninowej pakowanej osobno?

Ad. 181. Nie

182. dot. Pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na kamerę o wymiarach 16 x 250 cm, złożonego w sposób umożliwiający jałową aplikację? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu

Ad. 182. Tak

183. dot. Pakietu 18 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na ramię C o wym. 90 x 225 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 183. Nie

184. dot. Pakietu 18 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty

Ad. 184. Nie

185. dot. Pakietu 18 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca okrągłego o wymiarach 90 x 80 cm, grubość folii 50µm?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu

Ad. 185. Nie

186. dot. Pakietu 18 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca okrągłego o średnicy 120 cm, grubość folii 0,05mm?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu

Ad. 186. Nie

187. dot. Pakietu 18 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty

Ad. 187. Nie

188. dot. Pakietu 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMS, naklejka na fartuchu umożliwiająca identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem, informacja o rodzaju (wzmocniony) fartucha w postaci wyraźnego rysunku na opakowaniu zewnętrznym. Poziom pylenia strefa krytyczna: przód/rękaw fartucha 2,9 Log 10 (liczby cząstek), poziom pylenia w strefie niekrytycznej 2,4 Log 10 (liczby cząstek). Odporność na rozrywanie na sucho >146 kPa, na mokro >140 kPa. Dostępne rozmiary: S/M- długość fartucha 120 cm; L- długość 130 cm; XL- długość 150 cm; XL Long- długość 170 cm; XXL 150 cm- poszerzony dla operatorów o szerokich gabarytach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 188. Tak

189. dot. Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMS, naklejka na fartuchu umożliwiająca identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem, informacja o rodzaju (niewzmocniony) fartucha w postaci wyraźnego rysunku na opakowaniu zewnętrznym. Poziom pylenia 3,3 Log 10 (liczby cząstek). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Ad. 189. Tak

190. dot. Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej fartucha urologicznego przeznaczony do operacji urologicznych generujących dużą ilość płynów. Górna część fartucha (powyżej piersi)-bawełnopodobna, hydrofobowa paroprzepuszczalna włóknina o gramaturze 68g/m². Rękawy - nieprzemakalny (odporność na przenikanie cieczy min.150cmH₂O mierzona w/g PN EN 20811), chłonny laminat dwuwarstwowy (chłonna włóknina o gramaturze min.28g/m²) od wewnątrz oraz folia PE od zewnątrz. Pozostałe części fartucha, wykonane z wielowarstwowej nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48g/m²). Konstrukcja fartucha umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. Fartuch posiada kontrafałdy w przedniej części fartucha oraz zabezpiecza górną część pleców operującego. W tylnej części fartuch posiada zapięcie typu rzep oraz dwa troki służące zabezpieczeniu pleców operatora. Długość(mierzona od najwyższego punktu fartucha) 150cm. Fartuch dodatkowo zabezpieczony (owinięty)w papier krepowy. Fartuch bez elementów wykonanych z lateksu, pakowany razem z 1 szt. ręcznika do rąk. Całość w opakowaniu folia/papier. Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać dwie samoprzylepne naklejki służące do wklejania do dokumentacji medycznej. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Ad. 190. Tak

191. dot. Pakietu 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 45 x 75 cm o gramaturze 40,2 g/m²?

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ o rozmiarze 50 x 60 cm?

Ad. 191. Zamawiający nie wyraża zgody na gramaturę 40,2 g/m² oraz nie wyraża zgody na rozmiar 50x60.

192. dot. Pakietu 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ z otworem samoprzylepnym 6 cm?

Ad. 192. Nie

193. dot. Pakietu 20 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ z otworem samoprzylepnym 8 cm?

Ad. 193. Nie

194. dot. Pakietu 20 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 40,2 g/m²?

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 48 g/m²?

Ad. 194. Zamawiający nie wyraża zgody

195. dot. Pakietu 20 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 48 g/m²

Ad. 195. Nie

196. dot. Pakietu 20 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 48 g/m²

Ad. 196. Nie

197. dot. Pakietu 21 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni o wymiarach 38 x 40 cm z mocnej folii poliuretanowej bez sztywnika?

Ad. 197. Tak

198. dot. Pakietu 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, w którym serweta główna ma wymiar 225 x 300 cm a 109,5 g/m² w strefie krytycznej to wartość wzmocnienia wraz z laminatem podstawowym?

Ad. 198. [Tak](#)

199. dot. pakietu Nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92 cm typu kieszeń w kształcie różka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę?

Ad. 199. [Tak](#)

200. dot. Pakietu 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 21 g/m²?

Ad. 200. [Nie](#)

201. Dot. SIWZ p. 6.6

W związku z brakiem zapisu w Specyfikacji, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku niezłączenia do oferty próbek/dokumentów/folderów/kart danych technicznych, Zamawiający zastosuje art. 26 ust 3 Ustawy PZP.

Ad. 201. [Zamawiający nie jest zobowiązany do zamieszczenia informacji w SIWZ co zrobi w przypadku w/w braków. W przypadku wystąpienia powyższego Zamawiający postąpi zgodnie z uPzp.](#)

202. dot. Pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii barku o składzie :

1x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm

1x serweta na stół Mayo 78 x 145 cm;

3x taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,

1x osłona na kończynę 35 x 75 cm

4x ręczniki do rąk 40 x 40 cm

1x serweta pomocnicza 100x150 cm

1x serweta z wycięciem w kształcie litery „U” w rozmiarze 250x180 cm

1x serweta z wycięciem w kształcie litery „U” w rozmiarze 230x300 cm, wyposażona w zawór i zbiornik do przechwytywania płynów

Ad. 202. [Nie](#)

203. dot. Pakietu 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegu artroskopii kolana o składzie:

1x serweta na stół instrumentariuszki	150 x 190 cm
1x serweta na stół Mayo	80 x 145 cm;
2x taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm,
1x osłona na kończynę	35 x 80 cm
1x osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm, złożona teleskopowo, z taśmą mocującą	
1x serweta pomocnicza	100 x 150 cm
1x serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym otworem Ø7cm, zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka	
3x zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów	

Ad. 203. Tak

204. dot. Pakietu 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu PCNL z włókniny 3-warstwowej, laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni, o składzie :

1 x Serweta na stół instrumentariuszki 100cm x 150cm
1 x Serweta o wymiarach 180cm x 300cm z otworem min. 15x20cm otoczonym taśmą lepłą, pod otworem długi worek z usztywnionym brzegiem.

Ad. 204. Tak

205. dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw TUR o składzie :

1x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
4x ręczniki do rąk
1x serweta główna 200 x 240 z otworem, zintegrowanymi osłonami na kończyny, zbiornikiem wyposażonym w sito oraz zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum
2x zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Ad. 205. Tak

206. dot. Pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

1x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
1x serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
1x serweta dla noworodka 60 x 80 cm
4x ręczniki do rąk
1x serweta główna 160x300 z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
3x zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Ad. 206. Nie

207. dot. Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną :
Sterylną, wykonaną z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS o gramaturze min. 43g/m²
Rozmiar 130 x 150 cm
Otwór (9 x 11) wypełniony folią chirurgiczną
Zintegrowane dwa zbiorniki do odprowadzania płynów z kształtką do uformowania wlotu.

Ad. 207. [Nie](#)

208. dot. Pakietu 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 60cm z otworem ø6x8cm?

Ad. 208. [Nie](#)

209. dot. Pakietu 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 75cm x 90cm z otworem ø6x8cm lub ø8cm?

Ad. 209. [Nie](#)

210. dot. Pakietu 22 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny polipropylenowej lub włókniny polipropylenowej nieprzemakalnej laminowanej folią?

Ad. 210. [Nie](#)

211. dot. Pakietu 22 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny polipropylenowej nieprzemakalnej laminowanej folią?

Ad. 211. [Nie](#)

212. dot. Pakietu 22 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?

Ad. 212. [Tak](#)

213. dot. Pakietu 26

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze zielonym?

Ad. 213. [Tak](#)

214. dot. Pakietu 29 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4 z pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment?

Ad. 214. [Nie](#)

215. dot. Pakietu 29 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści matę antypoślizgową o wymiarach 75 x 100cm o wchłanianości min. 1,5l?

Ad. 215. [Nie](#)

216. dot. Pakietu 33

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 78cm x 145cm?

Ad. 216. [Tak](#)

217. dot. Pakietu 38

Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMMS?

Ad. 217. [Nie](#)

218. dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku o następującym składzie i wymiarach:

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do operacji barku w pozycji półsiedzącej (Beach Chair) o wym. 400x240 cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o wym. 10x10 cm, oraz zintegrowane taśmy samoprzylepne. Serweta wyposażona jest w worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu i dwa organizatory przewodów typu RZEP | 400x240 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna (wykonana z przezroczystej folii PE) o wym. 152x193 cm, z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 15x61 cm | 152x193 | 1 |
| 3. osłona na kończynę | 22x75 | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Ad. 218. [Tak](#)

219. dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści aby owinięcie zestawu miało wymiar 100 x 150 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 219. [Tak](#)

220. dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby obłożenie było wykonane z 2-wartswowego laminatu o gramaturze min. 63 g/m² ?

Ad. 220. [Dopuszcza się, ale nie wymaga.](#)

221. dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści aby serweta główna w zestawie miała wymiar 150 x 240 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 221. [Tak przy zachowaniu pozostałych parametrów.](#)

222. dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga aby obłożenie było wykonane z 2-wartswowego laminatu o gramaturze min. 63 g/m² ?

Ad. 222. [Dopuszcza się, ale nie wymaga](#)

223. dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści aby do zestawu zabiegów brzuszno-kroczych dostarczano osobno serwetę pod pośladki o wymiarach 75 x 90 cm ?

Ad. 223. [Nie](#)

224. dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści aby zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych posiadał dodatkowo 2 ręczniki przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 224. [Tak](#)

225. dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga aby obłożenie było wykonane z 2-wartswowego laminatu o gramaturze min. 63 g/m² ?

Ad. 225. [Dopuszcza się, ale nie wymaga](#)

226. dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści aby otwór w serwecie głównej posiadał wymiar 23 x 33 x 23 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 226. [Tak](#)

227. dotyczy Pakietu nr 18:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 sterylne pokrowiec o wymiarach 90 x 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 227. [Tak](#)

228. dotyczy Pakietu nr 19:

Czy Zamawiający ze względu na duże ilości asortymentu w pozycji 1 i 2 wymaga dostarczenia przez oferenta próbek także do tych pozycji ?

Ad. 228. Nie

229. dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z 4 ręcznikami w rozmiarze 30,5x34cm, osłoną na kończynę w rozmiarze 22cmx75cm, serwetą do artroskopii stawu barkowego w rozmiarze 263cmx406cm z samouszczelniającym się otworem w rozmiarze 13cmx14cm zintegrowaną z torbą na płyny, pozostały skład zestawu zgodny z SIWZ?

Ad. 229. Tak

230. dot. Pakietu 3


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z trzema taśmami lepnymi, z osłoną na kończynę w rozmiarze 22x75cm, serwetą o wymiarze 230x300cm ze wzmocnieniem wysokochłonnym w strefie krytycznej i otworem samouszczelniającym o średnicy 7 cm, pozostałe składowe zestawu jak w SIWZ?

Ad. 230. Tak

231. dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	rozmiar	ilość
serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów, z organizatorami przewodów	230cm x 320cm	1 szt.
ręcznik chłonny	30,5cm x 34cm	4 szt.
taśma samoprzylepna	10cm x 50cm	3 szt.
elastyczna osłona na kończynę	22cm x 75cm	1 szt.
wzmocniona osłona na stół Mayo	80cm x 145cm	1 szt.
serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150cm x 190cm	2 szt.

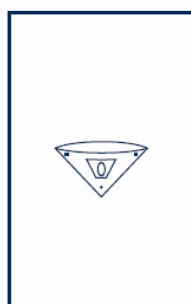

230x320cm
1szt./pc.



30,5x34cm
4szt./pcs




10x50cm
3szt./pcs



22x75cm
1szt./pc.



80x145cm
1szt./pc.




150x190cm
2szt./pcs

Ad. 231. Tak

232. dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	rozmiar	ilość
serweta do resekcji przezcewkowej z otworem brzuszny $\varnothing$ 6cm i kroczy $\varnothing$ 6cm, osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów ze sztywnikiem, filtrem, końcówką odpływową, osłona kończyny zintegrowana z całością serwety	190cm x 230cm	1 szt.
ręcznik chłonny	30cm x 30cm	4 szt.
taśma samoprzylepna	10cm x 50cm	1 szt.
serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150cm x 190cm	1 szt.




190x230cm
1szt./pc.



30x30cm
4szt./pcs



10x50cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

Ad. 232. [Tak](#)

233. **dot. Pakietu 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą nieprzemakalną na całej powierzchni wykonaną z trzywarstwowej włókniny SMS, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 233. [Tak](#)

234. **dot. Pakiet 14, pozycja 2**

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego z serwetami z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57g/m² + wysokochłonne wzmocnienie w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m² → łączna gramatura w strefie krytycznej 137g/m² z parametrami spełniającymi wymagania normy EN 13795; 1-3?
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzmocnioną osłonę (serwetę) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m²?
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzmocnioną serwetę na stół instrumentalny wykonaną z włókniny 30g/m² i folii PE 50 g/m² o chłonności 350%?

Ad. 234a) [Nie](#)

Ad. 234b) [Nie](#)

Ad. 234c) [Nie](#)

235. **dot. Pakietu 16**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej z trzywarstwowej, nieprzemakalnej na całej powierzchni włókniny SMS, rozmiar 120x170cm, z otworem 10x10cm wypełnionym folią operacyjną i z 2 torbami do zbiórki płynów i sztywnikiem + serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie serwety głównej?

Ad. 235. Nie

236. dot. Pakietu 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	rozmiar	ilość
serweta samoprzylepna, wzmocniona, z wycięciem „U” o wymiarach 6cm x 65cm, z organizatorami przewodów	150cm x 200cm	1 szt.
serweta samoprzylepna	150cm x 180cm	1 szt.
serweta samoprzylepna	75cm x 90cm	1 szt.
ręcznik chłonny	30cm x 30cm	4 szt.
taśma samoprzylepna	10cm x 50cm	1 szt.
wzmocniona osłona na stolik Mayo - czerwona	80cm x 140cm	1 szt.
serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150cm x 190cm	1 szt.

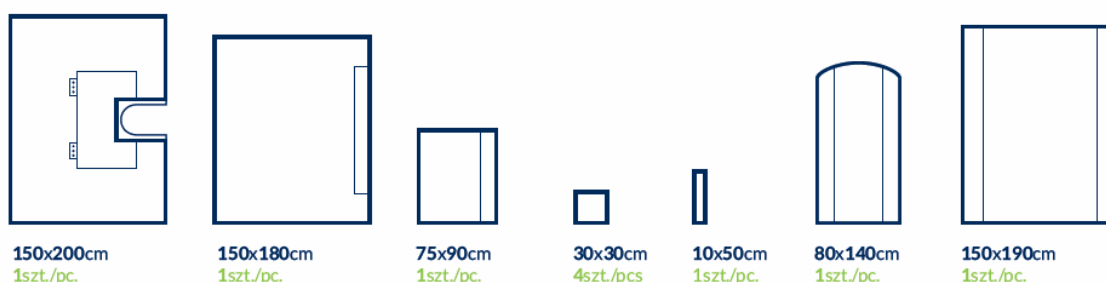

Ad. 236. Tak

237. dot. Pakietu 19, pozycja 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z 4 etykietkami samoprzylepnymi?

Ad. 237. Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

238. dot. Pakietu 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 38g/m z przodu fartucha i na rękawach?

Ad. 238. Nie

239. dot. Pakietu 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na wypychanie na sucho/mokro 155/150 kPa w strefie krytycznej i poziomie pylenia 2,5 Log10?

Ad. 239. Nie

240. dot. Pakietu 19, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na wypychanie na sucho/mokro 150/148 kPa w strefie krytycznej i poziomie pylenia 2,5 Log10?

Ad. 240. Nie

241. dot. Pakietu 19, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha urologicznego przeznaczonego do pracy z dużą ilością płynów, również w pozycji siedzącej, wykonanego z trzywarstwowej włókniny SMS 35g/m² + wzmocnienia 50 g/m² z dwuwarstwowego laminatu z przodu na całej długości i na rękawach → łączna gramatura w strefach krytycznych 85g/m², fartuch w uniwersalnym rozmiarze XXL?

Ad. 241. [Nie](#)

242. dot. Pakietu 22, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rolce o dł. 40 mb. Z przeliczeniem zamawianej ilości na 375 rolek?

Ad. 242. [Tak](#)

243. dot. Pakietu 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	rozmiar	ilość
wzmocniona serweta porodowa zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenażu	114cm x 150cm	1 szt.
ręcznik chłonny	30,5cm x 34cm	2 szt.
serweta chłonna dla noworodka	75cm x 85cm	1 szt.
serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150cm x 190cm	1 szt.




114x150cm
1szt./pc.



30,5x34cm
2szt./pcs



75x85cm
1szt./pc.




150x190cm
1szt./pc.

Ad. 243. [Nie](#)

244. dot. Pakietu 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	rozmiar	ilość
wzmocniona serweta porodowa zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu	114cm x 150cm	1 szt.
ręcznik chłonny	30,5cm x 34cm	2 szt.
serweta chłonna dla noworodka	75cm x 85cm	1 szt.
serweta wzmocniona na stół instrumentalny	150cm x 190cm	1 szt.

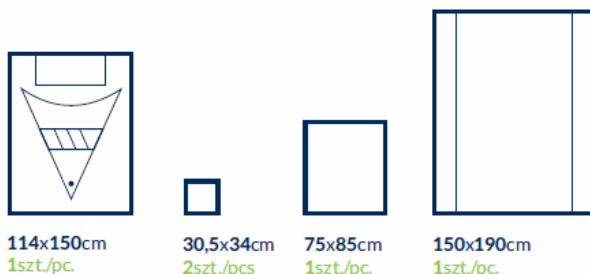

+ osobno pakowana dodatkowa torba do zbiórki płynów → całość pakowana w worek foliowy?

Ad. 244. Nie

245. dot. Pakietu 27, 35

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych?

Ad. 245. Zamawiający informuje, że produkty muszą być zgodne z wymogiem pkt. 3 ppkt. 6 SIWZ. Ponadto muszą spełniać inne wymagania wymienione m.in. w pkt. 6.6 ppkt. 3 i 4 SIWZ.

246. dot. pakietu 27

- a) Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do dezynfekcji pola o długości 23cm?
- b) Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40cm x 40cm?
- c) Czy Zamawiający dopuści igłę 0,8cm x 40mm?
- d) Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml trzyczęściową?

Ad. 246a),b),c),d) Nie

247. dot. Pakietu 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o właściwościach:

- rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm

- niesterylny
- rdzeń chłonny pikowany
- część zewnętrzna laminat nieprzemakalny
- chłonność min. 3850 ml

Ad. 247. [Nie](#)

248. dot. Pakietu 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik o szerokości 35cm?

Ad. 248. [Tak.](#)

249. dot. Pakietu 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowce o dł. 38 cm?

Ad. 249. [Tak.](#)

250. dot. Pakietu 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowce z wytrzymałej folii PE bez warstwy antypoślizgowej?

Ad. 250. [Tak.](#)

251. dot. Pakietu 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowce wytrzymałej włókniny z warstwą antypoślizgową?

Ad. 251. [Tak.](#)

252. dot. Pakietu 35, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu i utworzenie z niej odrębnego zadania? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Ad. 252. [Nie](#)

253. dot. Pakietu 35, pozycja 3

- a) Czy zamawiający dopuści kleszczyki do dezynfekcji pola o długości 23cm?
- b) Czy zamawiający dopuści miseczkę plastikową 120ml?
- c) Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Ad. 253a),b),c) [Nie](#)

254. dot. Pakietu 37

Czy zamawiający dopuści podkład o chłonności 810 ml?

Ad. 254. [Tak.](#)

255. dot. Pakietu 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L i XL – do

wyboru Zamawiającego?

Ad. 255. [Tak.](#)


256. dot. Pakietu 43

Czy zamawiający wymaga na opakowaniach pojedynczych i opakowaniach zbiorczych kodów EAN?

Ad. 256. [Dopuszcza, ale nie wymaga.](#)

257. dot. pakietu Nr 2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do artroskopii barku o następującym składzie:

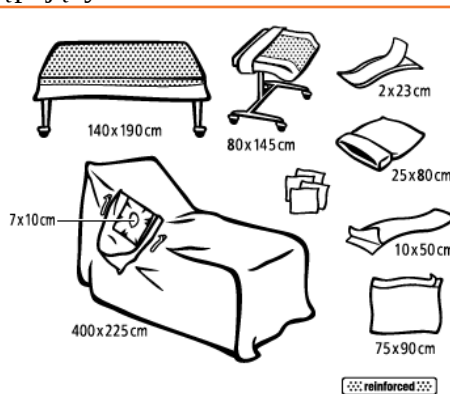	
Zestaw do artroskopii barku	
Skład zestawu:	
1 serweta na stółk narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stółk Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płynie (otwór 7 x 10 cm)	225 x 400
1 samoprzylepna serweta operacyjna	75 x 90
1 osłona na kończyne	25 x 80
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
1 uchwyt Velcro	2 x 23
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Ad. 257. [Tak.](#)


258. dot. Pakietu Nr 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów na stawie kolanowym zgodnego z SIWZ, jednakże w którym serweta główna ma samouszczelniający się otwór w rozmiarze 5 x 7 cm oraz który posiada w swoim składzie dodatkowo 1 serwetę nieprzylepną 150 x 175cm?

Ad. 258. [Tak.](#)

259. dot. pakietu Nr 4

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów artroskopii kolana o następującym składzie:

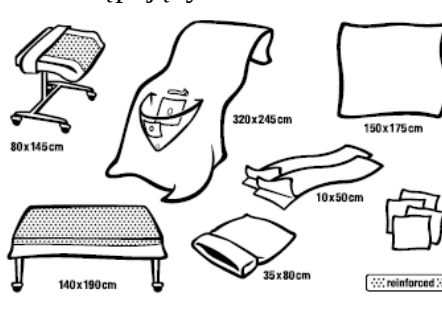	
Zestaw do artroskopii I	
Skład zestawu:	
1 serweta na stółk narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stółk Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta nieprzylepna	150 x 175
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwory 5 x 7 cm	320 x 245
1 osłona na kończyne	35 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Ad. 259. [Tak.](#)

260. dotyczy pakietu Nr 7


czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do przecewkowych zabiegów urologicznych o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta z laminatu dwuwarstwowego (PP/PE) do zabiegów urologicznych TUR ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, z oknem nieprzylepnym 7x 10 cm, torbą do zbierania płynów 50 x 70 cm (z sitem i drenem i zaworem), osłoną na palec bezlateksową 200 x 185 cm

Ad. 260. [Tak.](#)

261. dot. pakietu Nr 8

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów ginekologicznych dolnych o następującym składzie:

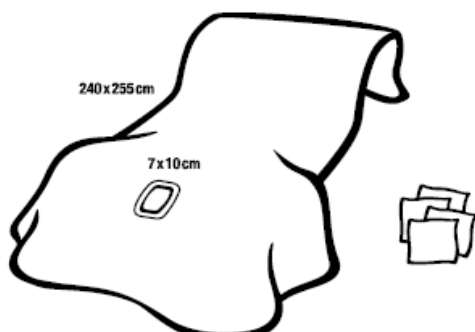

Zestaw ginekologiczny I

Skład zestawu:

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem (7 x 10 cm)	240 x 255
4 ręczniki celulozowe	30 x 33
Opakowanie dodatkowe - papier krepowy	

Ad. 261. [Nie](#)

262 . dot. pakietu Nr 10

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów brzuszno-kroczych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
 - 1 x serweta ginekologiczna 250 x 300 cm, otwór przylepny 9 x 12 cm. Wbudowane osłony na kończyny. Wbudowany worek na płyny
 - 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm
 - 1 x pojemnik na igły i skalpele 10 miejsc, magnetyczny
 - 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
 - 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
 - 1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
- Pokrowiec na stolik Mayo oraz kieszeń dwukomorowa w rozmiarze 43 x 38 cm pakowane oddzielnie, niezależnie od zestawu.

Ad. 262. [Nie](#)

263. dotyczy pakietu Nr 11

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którym serweta główna do cięcia

cesarskiego z torbą na płyny posiada okno wypełnione folią chirurgiczną, w rozmiarze 29 x 19 cm.

Ad. 263. [Tak](#)

264. dotyczy pakietu Nr 12

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 250 x 315 cm, otwór (folia operacyjna) 29 x 19 cm. Wbudowany worek na płyny 360 stopni
- 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek
- 4 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm biała 4 warstwy 20 nitek, z tasiemką
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 500 ml przezroczysty
- 1 x kleszczyki plastikowe 19 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Ad. 264. [Nie](#)

265. dotyczy pakietu Nr 14

Poz. 1 - czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych spełniającego wymagania SIWZ, jednakże wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m²?


Ad. 265. [Nie](#)

266. dotyczy pakietu Nr 14

Poz. 2 - czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych, wykonanego z laminatu z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej (3 warstwy) o gramaturze 110g/m² i z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² na brzegach serwet? Wypychanie na sucho/mokro w części krytycznej serwet 375/393 kPa.

Serweta na stolik narzędziowy wykonana z laminatu włókninowo – foliowego o całkowitej gramaturze 90g/m², folia polietylenowa 60µm, poziom absorpcji ok. 135 ml/m²
Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 85 x 145 cm z warstwą chłonną 60 x 145cm, wykonana z laminatu o całkowitej gramaturze 90g/m², folia polietylenowa 60µm.

Skład oferowanego zestawu:

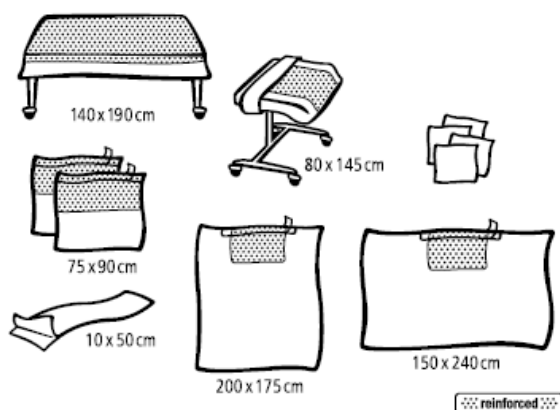

Uniwersalny zestaw pediatryczny
wzmocniony (cieńszy przylepiec
dla ochrony skóry)


Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	200 x 175
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Ad. 266. Nie

267. dotyczy pakietu Nr 16

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety okulistycznej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m², występującej w zestawie o następującym składzie:

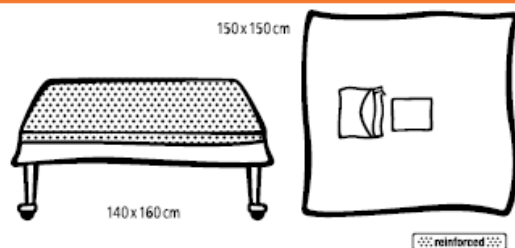

Zestaw IV okulistyczny

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 160
1 serweta okulistyczna z otworem przylepnym (folia operacyjna) i workiem na płyn, (otwór 10 x 12 cm)	150 x 150

Ad. 267. Tak

268. dotyczy pakietu Nr 17

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów laryngologicznych spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie 4 ściereczki chłonne.

Ad. 268. Tak

269. dotyczy pakietu Nr 19

Poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze 40g/m², materiał wzmocnień – przód fartucha oraz rękawy - 38g/m²? Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z włókniny SMS.. Poziom pylenia fartucha: 1,9 Log10 (liczby cząstek), odporność na rozrywanie na sucho/mokro 303/271 kPa

Ad. 269. Nie

270. dotyczy pakietu Nr 19

Poz. 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze 40g/m²? Wewnętrzne owinięcie

fartucha wykonane z włókniny SMS. Poziom pylenia fartucha: 2,3 Log10 (liczby cząstek), odporność na rozrywanie na sucho/mokro 186,0/174,0 kPa.

Ad. 270. Nie

271. dotyczy pakietu Nr 19

Poz. 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów urologicznych wykonanych z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m² (klatka piersiowa), rękawy – włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa, gramatura 65 g/m², korpus – folia polietylenowa gramatura 47 g/m².

Ad. 271. Nie

272. dotyczy pakietu Nr 21

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu do przewodów i drenów w rozmiarze 2 x 23cm, w opakowaniu a' 2 szt.?

Ad. 272. Nie

273. dotyczy pakietu Nr 21

Poz. nr 2- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 21 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania.

Ad. 273. Nie


274. dotyczy pakietu Nr 21

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni dwukomorowej w rozmiarze 43 x 38 cm wykonanej z mocnej półprzezroczystej, sztywnej folii, bez dodatkowego sztywnika ?

Ad. 274. Tak

275. dotyczy pakietu Nr 23

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy o następującym składzie:

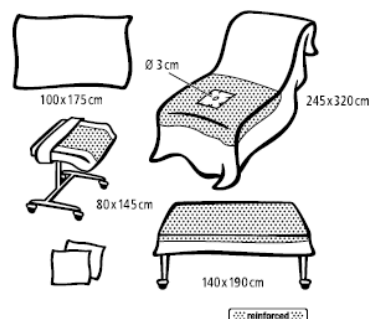

Zestaw do operacji dłoni/stopy I wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm)	320 x 245
1 serweta nieprzylepna	100 x 175
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

Serweta do operacji kończyny wykonana jest z laminatu o gramaturze 55g/m², wzmocnienie w części krytycznej 110 g/m². Serweta na stolik Mayo ma wzmocnienie 60 x 145cm.

Ad. 275. Tak

276. dotyczy pakietu Nr 27

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia zgodnego z SIWZ, jednakże w którym:

Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki ma wymiar 140cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 75cm x 190 cm – 1 szt.

Tupfer kula z gazy 17N, z nitką RTG (wykonany jest z gazy o wymiarach 34 cm x 34 cm) – 4 szt.

Ściereczki celulozowe w rozmiarze 30 cm x 33 cm – 4 szt.,

Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 175 cm x 150 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² – 2 szt.

Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 90 cm x 75 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m² - 2 szt.

Ad. 276. Nie

277. dotyczy pakietu Nr 31

Poz. nr 1,2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowców na buty będących wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent zakwalifikował je jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym

Ad. 277. Tak, wynika to z pkt. 3 ppkt. 6 SIWZ.

278. dotyczy pakietu Nr 37

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu higienicznego o chłonności min. 850g? Pozostałe parametry podkładu bez zmian.

Ad. 278. Tak

279. dotyczy pakietu Nr 41

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego, posiadającego mankiety zakończone lekko uciskającą gumką? Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Ad. 279. Nie

280. dot. pakietu 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczych o następującym składzie:

- włóknina SMS 112x112 cm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190 cm 50µm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 serweta z bilaminatu do laparoskopii 255 x306 cm z przylepnym oknem brzuszny 26x32 cm oraz przylepnym oknem kroczy 15x18cm z klapką, nogawice
- 1 przezroczysta przylepna torba na narzędzia 61x42,5 cm, 2 komory
- 1 taśma lepna 9x50cm
- 2 rękawiczki do rąk 58x39 cm rozłożone.

Ad. 280. Nie