



Elbląg, 24.02.2022 r.

Oznaczenie sprawy: SZZP.074.5.Pu/2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż i dostawę odzieży i elementów ochrony radiologicznej w 3 pakietach.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 21.02.2022 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 *Pakiet 1 pkt 2 oraz Pakiet 1 Wymagania dla poz. 1 i 2 ppkt. b)*

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby spódnica posiadała pas odciążający czy kamizelka?

W przypadku jeżeli funkcja odciążenia ma być realizowana przy spódnicy czy Zamawiający będzie wymagał aby spódnice były wyposażone we wszyty szeroki pas odciążający zapinany na rzep. Powyższe rozwiązania ułatwia zakładanie spódnicy oraz odciąża użytkownika poprzez dokładne rozłożenie ciężaru spódnicy na szerokim pasie.

Odp. 1 Zamawiający wymaga aby spódnica posiadała pas odciążający. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby spódnice były wyposażone we wszyty szeroki pas odciążający zapinany na rzep.

Pytanie 2 *Pakiet 1 pkt 2. oraz Pakiet 1 Wymagania dla poz. 1 i 2 ppkt. b)*

Prosimy o dopuszczenie kamizelki zapewniającej odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki, równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0,25mmPb.

Odp. 2 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 *Pakiet 1 Wymagania dla poz. 1 i 2 ppkt. a)*

W związku z różnym ciężarem mieszanek bezołowiowych na rynku, dochodzących nawet do 5,9 kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb, prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony radiologiczne były wykonane z ultralekkiego materiału bezołowiowego, którego ciężar nie przekracza 5,3kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb. Powyższy parametr gwarantuje otrzymanie przez Zamawiającego jednych z najlżejszych osłon na rynku oraz spełnienia wymogu fartuchów z materiału ultralekkiego.

Odp. 3 Zamawiający wymaga.

Pytanie 4 *Pakiet 1 Wymagania dla poz. 1 i 2 ppkt. a)*

Pragniemy poinformować, że zgodnie z obecnymi wymogami Rozporządzenia 2016/425 oraz na podstawie norm zharmonizowanych IEC 61331-1:2014 oraz IEC 61331-3-2014 wymaga się aby materiał bezołowiowy zapewniał maksymalne tłumienie w zakresie 60-110kV. W związku z tym prosimy o dopuszczenie bezołowiowej mieszanki antymonu i bizmutu, zapewniającej deklarowaną ochronę przy napięciu 60-110kV, zgodnej z obowiązującymi normami IEC 61331-1-2014, IEC

61331-3-2014.

Odp. 4 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 *Pakiet 1 Wymagania dla poz. 1 i 2 ppkt. d)*

Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia zgodności z aktualnymi normami IEC 61331-3:2014, IEC 61331-1:2014 oraz wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 Moduł B i D?

Odp. 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy w Załączniku Nr 1 ppkt c) i d) oraz w Zaprośzeniu pkt III ppkt 4.

Pytanie 6 *Pakiet 1 Wymagania dla poz. 1 i 2 ppkt. e)*

Prosimy o odstąpienie od wymogu poddania fartuchów recyklingowymi i usuwaniu w sposób bezpieczny.

Odp. 6 Zamawiający odstępuje od wymogu. Zamawiający dokonał zmian w Załączniku Nr 1.

Pytanie 7 *Pakiet 2 pkt. 1*

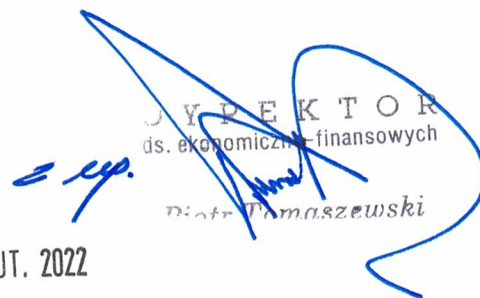
Prosimy o dopuszczenie osłony tarczycy w formie 5cm stójki ze śliniakiem i solidnym zapięciem na wytrzymałe rzepy z możliwością indywidualnego dopasowania do szyi, długość śliniaka 12 cm.

Odp. 7 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 *Pakiet 3 pkt. 1 ppkt 1*

W związku z różnym ciężarem mieszanek bezołowiowych na rynku dochodzącym nawet do 5,9 kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony radiologiczne były wykonane z ultralekkiego materiału bezołowiowego, którego ciężar nie przekracza 5,3kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb. Powyższy parametr gwarantuje otrzymanie przez Zamawiającego jednych z najlżejszych osłon na rynku oraz spełnienia wymogu fartuchów z materiału ultralekkiego.

Odp. 8 Zamawiający wymaga.


DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finansowych
Dziękuję
Dziękuję
24 LUT. 2022