

Oznaczenie sprawy: SZP.274.100.Pu.2024

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **sprzedaż, dostawę i oddanie do bieżącej eksploatacji zestawu narzędzi do resektoskopii i histeroskopii** dla potrzeb **Oddziału Ginekologicznego**.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania z dnia 25.10.2024 r., o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. Zestawu I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji nie starszym niż 2023? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź 1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w OPZ, tj. wymóg dotyczący roku produkcji 2024, który jest kluczowym elementem specyfikacji i jest warunkiem koniecznym do akceptacji oferty.

Pytanie nr 2 dot. Zestawu I

Dotyczy wymaganego okresu gwarancji 36 m-cy. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany minimalnego okresu gwarancji na 24 miesiące. Zapewnienie tak długiego, min. 36 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu przedmiotu umowy, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź 2.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w OPZ, tj. wymóg dotyczący gwarancji na sprzęt min. 36 miesięcy.

Pytanie nr 3 dot. Zestawu I

Czy Zamawiający dopuści następujący sprzęt:

Optyka HD+4K do resektoskopu; ø4mm, dł.=302mm, kąt patrzenia 30°

Element pracujący resektoskopu bipolarnego pasywny do połączenia z płaszczem ; długość całkowita: 238mm +/-1,5mm; długość robocza: 203mm +/-0,8mm;

Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 24/26 Ch do resektoskopu bipolarnego; ceramiczna końcówka o wzmocnionej trwałości; kod oznakowania żółty ; mocowanie płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego na „klik“

Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 26 Ch do resektoskopu bipolarnego; perforowane zakończenie; dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację ; matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiają optymalne przyleganie lubrykantu i dzięki temu atraumatyczne wprowadzanie urządzenia; długość całkowita: 212mm +/-1,5mm; długość robocza: 179mm +/-1mm; średnica 8,8mm

Obturator; 24/26 Ch kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, mocowane na „klik“

Kabel bipolarny do resektoskopu kompatybilny z posiadana przez Zamawiającego diatermią

Kosz do przechowywania i sterylizacji wykonany z siatki metalowej z pokrywą i matą silikonową;

Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z pokrywą i uchwytami silikonowymi.

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego sprzętu. Zamawiający wymaga spełnienia zapisanych w OPZ warunków i parametrów.

Pytanie nr 4 dot. Zestawu II

Czy Zamawiający dopuści następujący sprzęt:

Optyka HD+4K do resektoskopu; $\varnothing$ 4mm, dł.=302mm, kąt patrzenia 30°

Element pracujący resektoskopu bipolarnego pasywny do połączenia z płaszczem ; długość całkowita: 238mm +/-1,5mm; długość robocza: 203mm +/-0,8mm;

Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 24/26 Ch do resektoskopu bipolarnego; ceramiczna końcówka o wzmocnionej trwałości; kod oznakowania żółty ; mocowanie płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego na „klik“

Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 26 Ch do resektoskopu bipolarnego; perforowane zakończenie; dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację ; matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiają optymalne przyleganie lubrykantu i dzięki temu atraumatyczne wprowadzanie urządzenia; długość całkowita: 212mm +/-1,5mm; długość robocza: 179mm +/-1mm; średnica 8,8mm

Obturator; 24/26 Ch kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, mocowane na „klik“

Kabel bipolarny do resektoskopu kompatybilny z posiadana przez Zamawiającego diatermią

Kosz do przechowywania i sterylizacji wykonany z siatki metalowej z pokrywą i matą silikonową;

Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z pokrywą i uchwytami silikonowymi.

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego sprzętu. Zamawiający wymaga spełnienia zapisanych w OPZ warunków i parametrów.

Pytanie nr 5 dot. Zestawu I

Czy zamawiający dopuści w zestawie 1, pkt 6- Przewód bipolarny, dł. 450 cm, do zast. z resektoskopem bipolarnym?

Proszę o podanie typu złącza i modelu generatora z którym kabel ma być kompatybilny.

Odpowiedź 5.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego sprzętu.

Pytanie nr 6 dot. Zestawu I

Czy Zamawiający dopuści w zestawie 1, pkt 7- Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów: Kosz stalowy perforowany z wyposażony w matę silikonową typu język, zabezpieczającą przed swobodnym przemieszczaniem się narzędzi w koszu.

Odpowiedź 6.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego sprzętu.

Pytanie nr 7 dot. Załącznik nr 1 do SWZ - Zestaw I specyfikacji technicznej poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kosz druciany do przechowywania i sterylizacji optyk medycznych o dł. 460 mm, szer. 80 mm, wys. 55mm?

Odpowiedź 7.

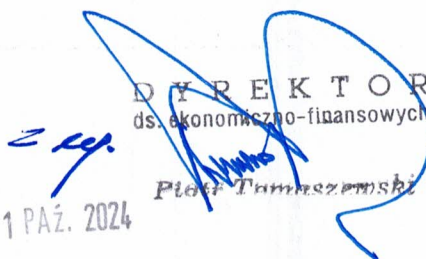
Zamawiający nie dopuszcza powyższego sprzętu.

Pytanie nr 8 dot. Załącznik nr 1 do SWZ Zestaw I specyfikacji technicznej poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kosz druciany z pokrywą do przechowywania i sterylizacji narzędzi, dedykowany do zestawów resektoskopowych. Wymiary kosza : dł. 480 mm, szer. 150mm, wys. 50mm?

Odpowiedź 8.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego sprzętu.


D Y R E K T O R
ds. ekonomiczno-finansowych
31 PAŹ. 2024
Piotr Tamaszewski

Wykonano: B. Zabrocka

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146
tel. 55 234 41 11 fax 55 234 56 12
NIP: 578-25-17-492 REGON: 170745930

Pieczętka zakładu

Elbląg, dnia 24.11.2023 r.

PEŁNOMOCNICTWO
Nr 012 - 19 /2023

Jako osoba upoważniona do jednoosobowej reprezentacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu** - ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg – niniejszym – na wypadek mojej nieobecności w siedzibie Szpitala – udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Panu Piotrowi Tomaszewskiemu

- legitymującemu się dowodem osobistym seria CBE nr 533400 wydanym przez Prezydenta Miasta Elbląg, do reprezentowania na zewnątrz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w zakresie podejmowania decyzji i podpisywania dokumentów w jego imieniu i na jego rzecz oraz dokonywania niezbędnych czynności wewnętrznych właściwych dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie podejmowania decyzji w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia 31.12.2024 roku.

KOPIA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
POŚWIADCZAM:
Elbląg, dnia 31.10.2024

Maciej Rzepa
RADCA PRAWNY
Gd. 280

Kontrolę formalno- prawną przeprowadził

24.11.2023 r.

(Data, podpis i pieczętka Rady Prawnego)

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert
(Podpis i pieczętka Dyrektora Naczelnego)

DYREKTOR
ds. ekonomiczno-finance

Piotr Tomaszewski

(Podpis upoważnionego)