

Znak sprawy 41/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 12.08.2014 r. pod numerem 269270–2014 na dostawę łóżek i wózków szpitalnych w czterech pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 14.08.2014r. oraz 18.08.2014 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dotyczy pakietu Nr 1 – łóżka szpitalne elektryczne – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *łóżko szpitalne elektryczne* wyposażone w zintegrowane barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka, zgodne z normą EN 60601-2-52 oraz krążki odbojowe zabezpieczające łóżko (w tym także barierki boczne)? Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas codziennego korzystania z łóżka.

Ad. 1. Tak**2. dotyczy pakietu Nr 1 – łóżka szpitalne elektryczne – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści *łóżko szpitalne elektryczne* posiadające leże o długości 198 cm? Oferowana długość jest parametrem lepszym, niż wskazana przez Zamawiającego.

Ad. 2. Tak**3. dotyczy pakietu Nr 1 – łóżka szpitalne elektryczne – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści *łóżko szpitalne elektryczne* posiadające elektryczną regulację pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburg do 15,5°? oferowany zakres będzie wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka.

Ad. 3. Tak**4. dotyczy pakietu Nr 1 – łóżka szpitalne elektryczne – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści *łóżko szpitalne elektryczne* wyposażone w tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami zgodne z normą EN 60601-2-52? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Ad. 4. Tak**5. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* o długości całkowitej 206 cm? Oferowana długość będzie praktyczna podczas codziennego korzystania z wózka.

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody**6. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* o szerokości całkowitej 81 cm? Oferowana szerokość różni się tylko o 1 cm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Ad. 6. Tak**7. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* posiadający wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem ≤ 68 cm? Oferowana wysokość różni się minimalnie od zakresu wskazanego przez Zamawiającego.

Ad. 7. Tak**8. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* posiadający pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej od 0° do min. 14,5°?

Oferowane rozwiązanie będzie wygodne podczas codziennego korzystania z wózka, a proponowany zakres jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego.

Ad. 8. Tak

9. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* posiadający segment uda regulowany płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, kąt nachylenia w stosunku do ramy leża w zakresie 0° - 18°? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas codziennego korzystania z wózka i pozwoli na uzyskanie wygodnej pozycji siedzącej.

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody

10. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* posiadający pod leżem listwę umożliwiającą montaż wyposażenia dodatkowego bez konieczności stosowania przesuwanych uchwytów? Oferowane rozwiązanie będzie równie praktyczne jak wskazane przez Zamawiającego.

Ad. 10. Tak

11. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* posiadający dźwignię (pedał) regulacji przechyłów wzdłużnych dostępny od strony wezglowia, po obu stronach wózka? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka.

Ad. 11. Tak

12. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych*, w którym każdy z rogów ramy wyposażony jest w krążki odbojowe? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające, aby zabezpieczyć wózek i ściany przed uszkodzeniami.

Ad. 12. Zamawiający nie wyraża zgody


13. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* wyposażony w cztery pojedyncze koła jezdne blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową? Oferowany parametr nie ma wpływu na walory funkcjonalno - użytkowe wózka.

Ad. 13. Tak, pod warunkiem, że koła pojedyncze będą miały średnicę min. 20 cm.

14. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* posiadający wyprofilowane w podstawie miejsce na butlę z tlenem? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

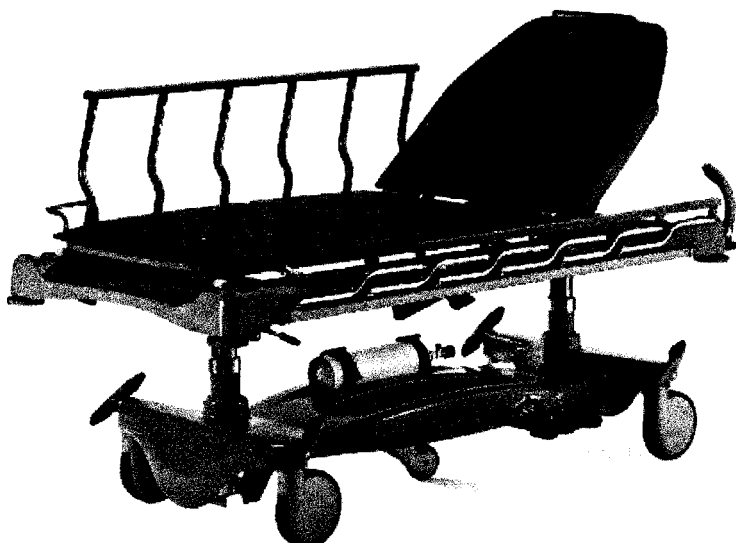

Ad. 14. Tak

15. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* o długości całkowitej 225 cm? Z uwagi na określenie przez Zamawiającego "wymiaru całkowitego" wynika ona z zastosowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych, takich jak krążki odbojowe i uchwyty do prowadzenia wózka, gwarantując przy tym zachowanie znormalizowanego rozmiaru leża.

Ad. 15. Zamawiający nie wyraża zgody

16. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* o szerokości całkowitej 76 cm? Oferowana szerokość będzie bardzo praktyczna podczas codziennego korzystania z wózka przy zachowaniu standardowego rozmiaru leża oraz zagwarantuje doskonały dostęp do pacjenta.

Ad. 16. Zamawiający nie wyraża zgody

17. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* posiadający wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny leża 68,5 cm? Oferowana wysokość różni się nieznacznie od zakresu wskazanego przez Zamawiającego.

Ad. 17. Tak

18. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* posiadający segment podudzia, regulowany płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, kąt nachylenia w stosunku do ramy leża w zakresie 0° - 27°? Oferowany zakres będzie wystarczający podczas codziennego korzystania z wózka i pozwoli na uzyskanie wygodnej pozycji siedzącej/fotelowej oraz kardiologicznej również na czas transportu pacjenta.

Ad. 18. Zamawiający nie wyraża zgody

19. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych*, w którym regulacje przechyłów wzdłużnych są wspomagane sprężynami gazowymi, przy użyciu przycisku umieszczonego od strony wezglowia? Oferowany parametr wynika z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i posiada dodatkowe walory bezpieczeństwa, wykluczając tym samym możliwość przypadkowego wciśnięcia dźwigni np. nogą podczas transportu.

Ad. 19. Tak

20. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy (dla pkt. 18) Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* posiadający zabezpieczenie przed uszkodzeniami w postaci całkowitej osłony leża wysoko-elastycznym poliuretanem, które spełnia funkcję odbojową? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze, aby zabezpieczyć wózek i ściany przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Ad. 20. Tak

21. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* wyposażony w bariery boczne opuszczane pod ramę leża? Oferowane rozwiązanie będzie bardzo praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka.

Ad. 21. Zamawiający nie wyraża zgody

22. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* wyposażony w dwa wieszaki kroplówki, wykonane ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości, zamocowane na stałe po bokach leża, z możliwością składania wzdłuż ramy leża w momencie ich niewykorzystywania lub podczas prowadzenia czynności ratunkowych? Oferowane rozwiązanie będzie bardzo praktyczne, gwarantując dodatkowe walory użytkowe.

Ad. 22. Zamawiający nie wyraża zgody


23. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych* wyposażony w cztery pojedyncze koła jezdne, blokowane centralne oraz dodatkowe piąte koło z funkcją kierunkową? Oferowane rozwiązanie jest bardzo profesjonalne i nie będzie mniej praktyczne, niż wskazane przez Zamawiającego.

Ad. 23. Zamawiający nie wyraża zgody

24. dotyczy pakietu Nr 2 – wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści *wózek do przewożenia chorych*, którego dźwignie blokady kół dostępne są w czterech miejscach wózka? Oferowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego i wynika z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

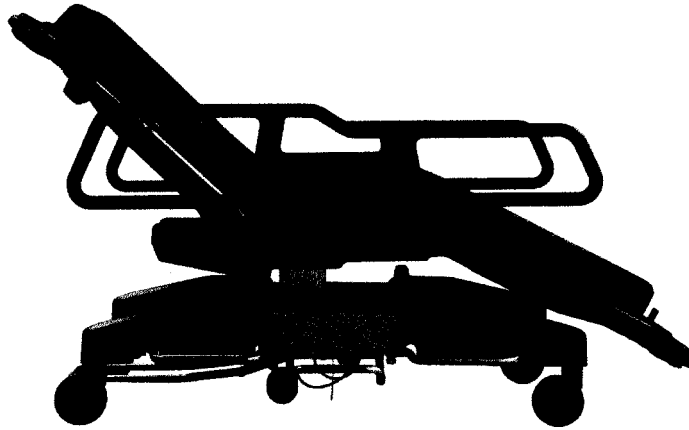

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody

25. dotyczy pakietu Nr 4 – łóżka rehabilitacyjne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści *łóżko rehabilitacyjne* wyposażone w zintegrowane barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka, zgodne z normą EN 60601-2-52 oraz krążki odbojowe zabezpieczające łóżko (w tym także barierki boczne)? Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas codziennego korzystania z łóżka.

Ad. 25. Tak

26. dotyczy pakietu Nr 4 – łóżka rehabilitacyjne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści *łóżko rehabilitacyjne* posiadające leże o długości 198 cm? Oferowana długość jest parametrem lepszym, niż wskazana przez Zamawiającego.

Ad. 26. Tak

27. dotyczy pakietu Nr 4 – łóżka rehabilitacyjne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści *łóżko rehabilitacyjne* posiadające elektryczną regulację pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburg do 15,5°? oferowany zakres będzie wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka.

Ad. 27.Tak

28. dotyczy pakietu Nr 4 – łóżka rehabilitacyjne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko *rehabilitacyjne* wyposażone w tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami zgodne z normą EN 60601-2-52? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Ad. 28. Tak

29. dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne zgodne z normą EN 60601-2-52 zabezpieczające pacjenta w min 60% powierzchni leża zgodnie z załączoną fotografią? Rozwiązanie takie w zupełności zabezpiecza pacjenta przed wypadnięciem a jednocześnie pozwala najłatwiejszy dostęp do pacjenta przez personel medyczny jak również pozwala na szybszą mobilizację pacjenta ułatwiając mu procesy mobilizacyjne w trakcie leczenia.



Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody

30. dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem czterosegmentowym wypełnionym płytą metalową malowaną proszkowo? Taka płyta jest mocniejsza i trwalsza zapewniająca większe bezpieczeństwo w trakcie resuscytacji pacjenta a jednocześnie łatwiejsza do utrzymania w czystości.

Ad. 30 Zamawiający nie wyraża zgody

31. dot. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o całkowitej szerokości przy podniesionych barierkach wynoszącej 100 cm i jednocześnie uzna za oczywistą pomyłkę zapis w tym punkcie mówiący o szerokości 970cm (+/- 3cm) ponieważ takie łóżka nie istnieją?

Ad. 31. Tak

32. dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko długości leża 196cm? Wymagana długość całkowita łóżka 220 cm z możliwością przedłużenia do 230 cm przy zachowaniu długości leża 190 cm spowoduje powstanie dużej przerwy w między leżem a szczytem łóżka co będzie miało zły wpływ na komfort pacjenta .

Ad. 32. Tak

33. dot. pkt. 21 i 22

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko elektryczną funkcją pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga w zakresie 0°-12°? Zakres ten jest w zupełności wystarczający do prze prowadzenia czynności reanimacyjnych pacjenta.

Ad. 33. Zamawiający nie wyraża zgody

34. dot. pkt. 24 i 25

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające mechaniczną funkcję CPR z dźwignią oznaczoną kolorem żółtym? Mechaniczny CPR jest skuteczniejszy i zdecydowanie szybszy od funkcji elektrycznej a kolor żółty czy czerwony dźwigni nie mają wpływu na parametry techniczne łóżka a jedynie spełniają funkcję widocznego , różniącego się od kolorystyki łóżka elementu łatwego do lokalizacji .

Ad. 34. Tak

35. dot. pkt. 28

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko w którym elektryczną pozycję antyszokową uzyskujemy przy użyciu 1 przycisku w momencie poziomego leża a w przypadku innej pozycji leża przy użyciu max. dwóch przycisków?

Ad. 35. Tak

36. dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki bez dodatkowego pilota?

Ad. 36. Zamawiający nie wyraża zgody

37. Czy zamawiający oczekuje aby barierki boczne były wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia płyty plecowej i leża widoczne w każdej pozycji barierki? Jest to rozwiązanie terapeutycznie zalecane ze względu na stałą kontrolę położenia segmentów i leża podczas procesu leczenia i kontroli pacjenta.

Ad. 37. Nie wymaga

38. dot. zadania Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowe z pełną gwarancją fabrycznie zapakowane wózki z data produkcji 2012 ? Takie wózki znajdują się na wyposażeniu Bloku operacyjnego w Szpitalu .



Ad. 38. Zamawiający nie wyraża zgody

39. dot. zadania Nr 2 – pkt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza wózek z szerokością całkowitą 80 cm? jest to różnica zaledwie 2 cm od dopuszczzonej w SIWZ.

Ad. 39. Tak

40. dot. zadania Nr 2 – pkt. 6 i 7

Czy zamawiający dopuszcza wózek z hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i atyTrendelenurga w zakresie 18°?

Ad. 40. Tak

41. dot. zadania Nr 2 – pkt. 8

Czy Zamawiający dopuszcza wózek z leżem dwusegmentowym wykonanym z płyty przeziernej dla promieni RTG i prowadnica dla kaset RTG na całej długości leża ?

Ad. 41. Zamawiający nie wyraża zgody

42. dot. zadania Nr 2 – pkt. 12

Czy Zamawiający dopuszcza wózek bez szyny na montaż dodatkowego wyposażenia a z możliwością montażu stojaków na płyny infuzyjne w ramie wózka od strony głowy lub nóg.?

Ad. 42. Zamawiający nie wyraża zgody

43. dot. zadania Nr 2 – pkt. 23

Czy Zamawiający dopuszcza wózek z centralną blokadą wszystkich kół ? jest to rozwiązanie lepsze od blokady każdego koła osobno.

Ad. 43. Zamawiający nie wyraża zgody

44. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej załączników z parametrami technicznymi formularza ofertowego.

Ad. 44. Zamawiający nie udostępni wersji edytowalnej na stronie szpitala.

45. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie Szpitala SIWZ w formie edytowalnej

Ad. 45 Zamawiający nie udostępni wersji edytowalnej na stronie szpitala.

46. Dot. załącznika nr 2,3,4,

Czy Zamawiający uzna Deklarację Zgodności jako dokument wystarczający potwierdzenie posiadanie znaku CE.

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) dla klasy I wyrobów medycznych certyfikat CE nie jest wymagany.

Ad. 46. Tak, Zamawiający uzna Deklarację Zgodności jako dokument wystarczający na potwierdzenie posiadanie znaku CE

47. Dot. załączników nr 1, 2,3,4

Wnosimy o usunięcie wymogu potwierdzenia posiadania **Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych jako niezgodnego z aktualną Ustawą o Wyrobach Medycznych** z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679).

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) wpis do RWM przestał obowiązywać, został zastąpiony koniecznością zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgodnie z art. 58 ust.3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że nawet gdyby Wykonawca chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia.

W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego też powodu dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia. **Jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).**

Ad. 47. Tak, Zamawiający wykreśla z załączników 1,3,4 wymóg posiadania Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Wiążący dla Wykonawcy w tym zakresie jest wymóg pkt. 6.5 ppkt. 1 SIWZ, w którym mowa o dokumentach dopuszczających do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

48. Dotyczy SIWZ oraz załączników 1,2,3, 4 („gwarancja i serwis”)

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika)

akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Ad. 48. Zamawiający wyjaśnia, że gwarancja obejmuje wszystkie elementy wózków i łóżek w okresie 36 miesięcy gwarancji. Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. gwarancji zawarte w SIWZ.

49. Dot. załączników nr 1,2,3,4 „przeglądy eksploatacyjne pkt. 4”:
Prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Odpłatne materiały eksploatacyjne – dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnianiem.

Ad. 49. Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do powszechnie obowiązującego tj. do 24 miesięcy.
Obecny wymóg 36 miesięcznej gwarancji znacznie podroży cenę oferty.

Ad. 50. Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ

51. Dotyczy załącznik 1,2,3,4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia.
Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

Ad. 51. Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ

52. Dotyczy załącznik 1,2,3,4
Prosimy o wydłużenie maksymalnego czasu naprawy do 14 dni w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Ad. 52. Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ

53. Dot. załącznik 1,2,3,4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?
Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Ad. 53. Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ

- 54.** Dotyczy załącznik nr 9 – wzór umowy par. 5 ust 2:
Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących odsetek na: Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Ad. 54 Zamawiający nie wyraża zgody

- 55.** Dotyczy Załącznik nr 9 – wzór umowy §7 ust. 1
Wnosimy o modyfikację ww. zapisu tak, aby otrzymał następujące brzmienie: *„Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto wartości niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki.”.*

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Ad. 55 Zamawiający nie wyraża zgody

- 56.** Dotyczy Załącznik nr 9 – wzór umowy §7 ust. 2
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej w przypadku napraw wydłużających się ponad wymagany termin na 0,1% wartości brutto naprawianego urządzenia.

Ad. 56 Zamawiający nie wyraża zgody

- 57.** Dotyczy Załącznik nr 9 – wzór umowy §7 ust. 3
Prosimy o zmianę kary umownej w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Ad. 57 Zamawiający nie wyraża zgody

- 58.** Dotyczy Załącznik nr 9 – wzór umowy §8
Wnosimy o modyfikację ww. zapisu tak, aby otrzymał następujące brzmienie:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Ad. 58 Zamawiający nie wyraża zgody

- 59.** Dotyczy Załącznik nr 9 – wzór umowy 10

Wnosimy o modyfikację ww. zapisu tak, aby otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy z wyznaczonym mu w tym celu terminem, nie krótszym jednak niż 21 dni.”

Ad. 59 Zamawiający nie wyraża zgody

60. dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta na całej powierzchni leża zgodnie z normą PN-EN 60601-2-52 bez możliwości przedłużenia barierki w momencie wydłużenia leża?

Barierki w naszym łóżku zaprojektowano i wykonano według normy, na którą powołuje się Zamawiający i zabezpieczają całą długość leża bez możliwości przedłużenia.

Ad. 60. Tak

61. dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z leżem wypełnionym odejmowanymi płytami z tworzywa HPL?

Wypełnienie segmentów leża płytą HPL nie wpływa na jakość użytkowania ani na bezpieczeństwo pacjentów. Płyta HPL jest przezierna dla promieni RTG, łatwa do utrzymania w czystości, wytrzymała i można ją dezynfekować szpitalnymi środkami czystości.

Ad. 61. Tak

62. dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne o długości leża 2000 mm?

Długość leża w naszym łóżku jest większa niż oczekiwana przez Zamawiającego, natomiast długość całkowita łóżka nie jest większa niż oczekiwana, więc pacjent wykorzystuje większą powierzchnię do leżenia przy zachowaniu tych samych gabarytów zewnętrznych, co wpłynie korzystnie na komfort pacjenta.

Ad. 62. Tak

63. dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zintegrowane barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka zgodnie z normą EN 60601-2-52 wyposażone w jednoosiowe krążki odbojowe zabezpieczające barierki boczne?

Ad. 63. Tak

64. dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości maksymalnej 101 cm czyli tylko o 1 cm szersze od opisanego?

Ad. 64. Zamawiający nie wyraża zgody

65. dotyczy pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości leża 200 cm?

Ad. 65. Tak

- 66. dotyczy pakietu Nr 1**
Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 450-850mm?

Ad. 66. Tak

- 67. dotyczy pakietu Nr 1**
Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem lub tkaniną zmywalną, łatwą do dezynfekcji, która eliminuje drobnoustroje, o właściwościach półprzepuszczalnych czyli paroprzepuszczalny i nieprzepuszczający cieczy?

Ad. 67. Zamawiający nie wyraża zgody

- 68. dotyczy pakietu Nr 2**
Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości minimalnej leża 680mm?

Ad. 68. Tak

- 69. dotyczy pakietu Nr 2**
Czy Zamawiający dopuści segment uda z regulowanym za pomocą mechanizmu zapadkowego kąta nachylenia w stosunku do ramy leża w zakresie 0-20°, z blokadą?

Ad. 69. Zamawiający nie wyraża zgody

- 70. dotyczy pakietu Nr 2**
Czy Zamawiający dopuści wózek z ramą-listwą pod leżem przystosowaną do zawieszenia wyposażenia dodatkowego?

Ad. 70. Tak

- 71. dotyczy pakietu Nr 2**
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych realizowanych w wygodniejszy sposób poprzez pedały nożne umieszczone po obu stronach wózka?

Ad. 71. Tak

- 72. dotyczy pakietu Nr 2**
Czy Zamawiający dopuści wózek, gdzie każdy z rogów ramy jest wyposażony w jednoosiowe krążki odbojowe spełniające również funkcje ochronne jak listwy odbojowe?

Ad. 72. Zamawiający nie wyraża zgody

- 73. dotyczy pakietu Nr 2**
Czy Zamawiający dopuści wózek z czterema pojedynczymi, ale dużymi (średnica 200mm) kołami jezdnyymi z blokadą centralną i blokadą kierunkową?

Ad. 73. Tak

- 74. dotyczy pakietu Nr 2**
Czy Zamawiający dopuści wózek z podstawą jezdnią ukształtowaną specjalnie do przewożenia butli z tlenem, które jest lepszym rozwiązaniem niż kosz na butlę?

Ad. 74. Tak

75. dotyczy pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zintegrowane barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka zgodnie z normą EN 60601-2-52 wyposażone w jednoosiowe krążki odbojowe zabezpieczające barierki boczne?

Ad. 75. Tak

76. dotyczy pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości maksymalnej 101cm czyli tylko o 1 cm szersze od opisanego?

Ad. 76. Zamawiający nie wyraża zgody

77. dotyczy pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości leża 200 cm?

Ad. 77. Tak

78. dotyczy pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 450-850mm?

Ad. 78. Tak

79. dotyczy pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem lub tkaniną zmywalną, łatwą do dezynfekcji, która eliminuje drobnoustroje, o właściwościach półprzepuszczających czyli paroprzepuszczalny i nieprzepuszczający cieczy?

Ad. 79. Zamawiający nie wyraża zgody

80. dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zintegrowane barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka zgodnie z normą EN 60601-2-52 wyposażone w jednoosiowe krążki odbojowe zabezpieczające barierki boczne?

Ad. 80. Tak

81. dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości maksymalnej 101 cm czyli tylko o 1 cm szersze od opisanego?

Ad. 81. Zamawiający nie wyraża zgody

82. dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości leża 200 cm?

Ad. 82. Tak

83. dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 450-850mm?

Ad. 83. Tak

84. dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem lub tkaniną zmywalną, łatwą do dezynfekcji, która eliminuje drobnoustroje, o właściwościach półprzepuszczalnych czyli paroprzepuszczalny i nieprzepuszczający cieczy?

Ad. 84. Zamawiający nie wyraża zgody

85. dotyczy pakietu Nr 4

Jaki uchwyt uniwersalny ma Zamawiający na myśli – punkt 40?

Ad. 85 Uchwyt uniwersalny - forma haczyka do zawieszenia wyposażenia

86. dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami na worki urologiczne po obu stronach łóżka zamiast kosza?

Ad. 86. Zamawiający nie wyraża zgody